

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๐๙๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๓๔๑ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) ศรีราชาทวนอินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดย นายวชิรวิวัฒน์ นวบุษสิทธิ์รัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๒๙๔๗๓ ออกให้ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- เครื่องวัดปริมาณความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง
- และอัตราการเต้นของชีพจรแบบพกพา

รวมเป็นราคาทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔,๓๑๗.๗๖ บาท (สี่พันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑	ผนวก ๑ (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)	จำนวน ๒	(สอง) หน้า
๓.๒	ผนวก ๒ (แคตตาล็อก)	จำนวน ๒	(สอง) หน้า
๓.๓	ผนวก ๓ (ใบเสนอราคา)	จำนวน ๑	(หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ กรณีมีข้อขัดแย้งของผู้ซื้อ ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวชิรวิวัฒน์ นวบุษสิทธิ์รัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เทคโนโลยี จำกัด

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือขอลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน


ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ ปี-....เดือน ...-... วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อ มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อ มีสิทธิบังคับค่าจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นายชริวิวัฒน์ นวบุษสิมริรัตน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เทคเอช จำกัด

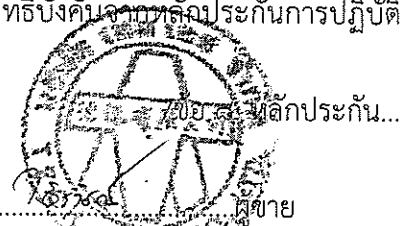

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ หนังสือค้ำประกันเลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๕๓/๐๑๑๖/๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๐๐.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา..ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....
(นายวชิรวิชณ์ นวบษุทธิ์รัตน)
ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท เทคเอช จำกัด



ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ (๐.๒%) ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสินค้าของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ผู้ซื้อต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวชิรวิวัฒน์ นวบุษสิทธิ์รัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เทคเอช จำกัด



ถ้าผู้ขาย...

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
งหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้ผู้ซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน
บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบใด


ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้
หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อแต่จะ
ขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระ
เงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายวชิรวิชฌ์ นวบุษสิทธิ์รัตน์)
ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท เทคเอช จำกัด



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปลัดอำเภอผู้ช่วยฯ แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวชิรวิวัฒน์ นวบุษสิทธิ์รัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนิต ปานรอด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของ
ชีพจรแบบพกพา

๑. ความต้องการ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของชีพจรแบบพกพา

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เครื่องวัดและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO_2) และอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse) อย่างต่อเนื่องชนิดพกพา ด้วยระบบ Non-Invasive
- ๒.๒ ใช้คลื่นแสงที่มีความยาวคลื่น ๖๖๐ และ ๙๑๐ นาโนเมตร
- ๒.๓ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก กะทัดรัด สะดวกแก่การพกพา
- ๒.๔ ตัวเครื่องทำงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน ๔ ก้อน สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้
- ๒.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ UL และ FDA เป็นอย่างน้อย
- ๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศไทย

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ภาคการวัดค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2)
 - ๓.๑.๑ สามารถวัดและแสดงค่าได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๐-๑๐๐%
 - ๓.๑.๒ ค่าความเที่ยงตรงในช่วงการวัดค่าระหว่าง ๗๐-๑๐๐% ในกรณีที่ผู้ป่วยผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่มีภาวะ No Motion ไม่มากกว่า ± 2 digits และภาวะที่มี Motion หรือ Low Perfusion ไม่มากกว่า ± 3 digits เมื่อใช้ Finger Clip Sensor สำหรับการวัดค่า
- ๓.๒ ภาคการวัดค่าอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate)
 - ๓.๒.๑ สามารถวัดและแสดงค่าได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๘-๓๒๑ ครั้งต่อนาที
 - ๓.๒.๒ มีค่าความเที่ยงตรงในกรณีที่ผู้ป่วยผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่มีภาวะแบบ No motion หรือ Low Perfusion ไม่มากกว่า ± 3 digits และภาวะที่มี Motion ไม่มากกว่า ± 5 digits
- ๓.๓ จอแสดงผลเป็นชนิด LED สีแดง มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง
- ๓.๔ สามารถใส่แบตเตอรี่ โดยการเลื่อนฝาเปิดปิด (Slide) โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด AA Alkaline ๑.๕V จำนวน ๔ ก้อน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จประจุไฟเข้าได้ชนิด NiMH โดยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง เมื่อชาร์จประจุไฟเต็ม
- ๓.๕ มีสัญญาณไฟแสดงคุณภาพของชีพจร ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนสีได้ ๓ สี (Tricolor) คือ แดง เหลือง อัมพัน และเขียว ตามคุณภาพของสัญญาณชีพจรที่ได้รับ และมีสัญญาณ ไฟเตือนเมื่อประจุแบตเตอรี่อ่อน
- ๓.๖ สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเครื่องบินได้สูงถึงระดับ ๔๐,๐๐๐ ฟุต และที่มีแรงดัน ๔ บรรยากาศ

/๔. อุปกรณ์มาตรฐาน...

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางบัวไข เกื่อนทนนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ


(นางบุษปากร ไสภคณิสฐ์)

(นางสาวประภัสสร พงษ์รุ่งเรือง)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

PalmSAT

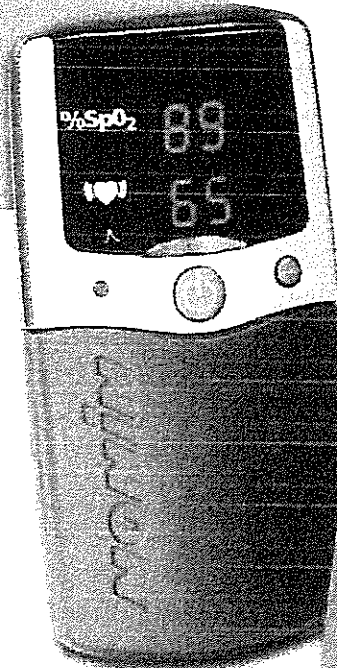


PalmSAT 2500

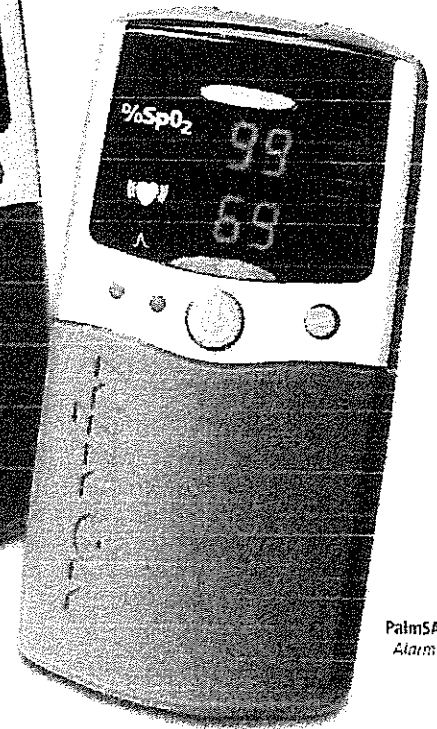

PalmSAT 25
Alarm Vers

Proven Performance in Real World Applications

PalmSAT® – the next generation in handheld pulse oximetry – small yet versatile digital pulse oximeters designed to accurately assess oxygen saturation and pulse rate. The compact size, ease of operation, exceptional battery life and choice of alarm or non-alarm versions make the PalmSAT 2500 Series ideal for your portable monitoring needs – regardless of the patient's location.



NONIN

PalmSAT 2500 Series

Product Highlights

- 1000USB Adapter & 1000USB-C (Continua Certified)
- nVISION™ Data Management Software
- PC Interface Cable
- Carrying Case
- PureLight™ Sensors
- PalmSAT Charger Stand & NiMH Battery Pack


Nonin has combined advanced technology and algorithms based on years of invaluable clinical experience to provide a wide range of functions. The functionality of the PalmSAT 2500 Series also makes it useful for an array of medical locations and applications:

- Hospitals
- Pre- and Post-Op
- Procedure Rooms
- Urgent Care
- screening
- Physicians Offices
- Same-Day Surgery
- Emergency Services
- Transport
- Nursing Homes
- Sleep Studies – basic overnight
- Dental and Oral Surgery

Nonin's optional Windows™-based software package, nVISION™, permits the seamless transfer of all stored data from 72 hours of memory to a PC for further analysis, comprehensive report generation and storage.


1000USB Adapter & 1000USB-C (Continua Certified)

Nonin Medical's 1000USB adapter enables fast and convenient download of secure data to a receiving device such as a personal computer, and a patient sensor for data collection and transfer.



Accessories

Many options allow you to customize the PalmSAT 2500 Series to meet your application needs.



Carrying Case

- PureLight™ Sensors
- PalmSAT Charger Stand & NiMH Battery Pack
- nVISION Data Management Software
- PC Interface Cable
- Carrying Case




- PalmSAT 2500 Series**
all of these sensors:
- Finger Clip Sensors**
R000AA1, R000AA2, R000AA3, R000AA4, R000AA5
 - Soft Sensors**
R00000, R00001, R00002
 - Flex Sensors**
R00003, R00004, R00005, R00006
 - Ear Clip Sensors**
R00007
 - Forehead Sensors**
R00008, R00009
 - Flexi-Form II Sensors**
T000A, T000B, T000C, T000D, T000E, T000F, T000G, T000H, R00010, R00011

Specifications


Dimensions	7.0 cm (2.8") W x 13.8 cm (5.4") H x 3.2 cm (1.3") D
Weight	2500: 210 grams (7.4 oz) (with alkaline bat) 2500A: 213 grams (7.5 oz) (with alkaline bat)
Oxygen Saturation Display Range	0 - 100% SpO ₂
Pulse Rate Display Range	18 - 321 beats per minute (BPM)
Saturation Declared Accuracy (A₉₅)*	70 - 100%
	Adults/Pediatrics Neonates
No Motion:	Finger Clip ±2 digits N/A Flex ±3 digits N/A
Motion:	Finger Clip ±3 digits N/A Flex ±3 digits N/A
Low Perfusion:	Finger Clip ±3 digits N/A Flex, Flexi-Form II ±3 digits ±4 digits
Pulse Rate Declared Accuracy	
No Motion:	18 - 300 BPM
Motion:	40 - 240 BPM
Low Perfusion:	40 - 240 BPM
	Adults/Pediatrics Neonates
No Motion:	Finger Clip ±3 digits N/A Flex, Flexi-Form II ±3 digits ±3 digits
Motion:	Finger Clip ±5 digits N/A Flex ±5 digits N/A
Low Perfusion:	Finger Clip ±3 digits N/A Flex, Flexi-Form II ±3 digits ±3 digits
Measurement Wavelengths and Output Power**	
Red	660 nanometers @ 0.8 mW maximum
Infrared	910 nanometers @ 1.2 mW maximum
Indicators	
Pulse Quality Display	LED, tricolor
Numeric Displays	3-digit 7-segment LEDs, red
Low Battery Indicator	LED, amber
Temperature	
Operating	-20 to +50°C (-4 to +122°F)
Storage/Transportation	-30 to +50°C (-22 to +122°F)
Humidity	
Operating	10 - 90% noncondensing
Storage/Transportation	10 - 95% noncondensing
Altitude	
Operating	Up to 12,000 meters (40,000 feet)
Hyperbaric Pressure	Up to 4 atmospheres
Power Requirements	Four 1.5V AA-size alkaline batteries (21 hours typical operation, 2500A: 60 hr typical operation) or NiMH rechargeable battery pack (40 hours typical operation)
Classifications per IEC 60601-1 / CSA601.1 / UL60601-1	
Type of Protection:	Internally powered (on battery power)
Degree of Protection:	Type BF-Applied Part
Mode of Operation:	Continuous
Enclosure Degree of Ingress Protection:	IPX2

* ± 1 Arms represents approximately 68% of measurements
** This information is especially useful for clinicians performing photodynamic therapy

Specifications are subject to change without notice.



13700 1st Avenue North • Plymouth, MN • 55441-5443 • USA
+1 763.553.9968 • 800.356.8874 • +1.763.577.5521
info@nonin.com





บริษัท เทคเอช จำกัด

1341 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญญามิตร) ศรีวิภาทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 029347360 โทรสาร 025303865 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105528001039


ใบเสนอราคา

เลขที่	QC6304-00065
วันที่	

ชื่อผู้ติดต่อ	ผู้อำนวยการ	กำหนดส่ง	30 วัน
ชื่อบริษัท	โรงพยาบาลบางพลี	ยื่นราคาภายใน (วัน)	60 วัน
โทร.	02-3122268	โทรสาร	
		จำนวนวันเครดิต	90 วัน

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
NON_4852-000	เครื่องวัดและติดตามปริมาณความอืดตัวของออกซิเจน ในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรแบบพกพา รุ่น PATMSAT2500 ประเภทตัวผ - FINGER PROBE ADULT 1 M. แถบ - กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ NONIN ประเทศสหรัฐอเมริกา	3	เครื่อง	33,000.00		99,000.00

หมายเหตุ รับประกันตัวเครื่อง 12 เดือน รับประกันอุปกรณ์ 6 เดือน (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	รวมเงิน	99,000.00
	ส่วนลดการค้า	
	เงินหลังหักส่วนลด	92,523.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	6,476.64
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	99,000.00

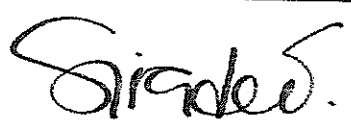_____ ผู้อนุมัติซื้อ วันที่ ____ / ____ / ____	_____ คุณวชิรวิทย์ นวบุญฉัตรรัตน์ / 081-679-9193 พนักงานขาย วันที่ ____ / ____ / ____	 _____ นางสาว ศิระดีร์ เศษศรีสุขโข ผู้จัดการฝ่ายขาย วันที่ ____ / ____ / ____
--	--	--

7631665