

สัญญาซื้อขายเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant warmer)

จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่ ๘๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๘๔๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G/๒, ชั้น ๑, ชั้น ๒ อาคารเลขที่ ๑๐/๑๑ หมู่ที่ ๑๖ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวาริรัตน์ สุดสงวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๑๐๗๑๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจช่วง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant warmer) จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๐๔๖.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๘ (แปด)	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวาริรัตน์ สุดสงวน)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

/ความใดใน...



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไขทรัพย์สภาร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาววารีรัตน์ สุดสงวน)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้อีกผู้หนึ่งแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้อีกผู้หนึ่งทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ครินทร กม.๑๕ เลขที่ ๑๐๐๐๕๒๓๔๗๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลง หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไข่ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ภูมิตราสารการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาววาริรัตน์ สุดสงวน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

/ข้อ ๙ การบอกเลิก...



ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเติมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าส่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

/ข้อ ๑๒ การงดหรือ...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไขทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ๒ รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาววาริรัตน์ สุดสงวน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอลซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ๒ รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย


(นางสาววารีรัตน์ สุดสงวน)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก

บริษัท ไอทีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด




สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ
(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย
(นางสาววารีรัตน์ สุดสงวน)
ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสายชล ธีรวิชิตรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant warmer)

๑. ความต้องการ

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดที่ป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤติ เพื่อปรับและควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับภาวะของโรคและแผนการรักษา

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นรถเข็นมีที่นอนเด็กใช้กับทารกแรกคลอดในห้องคลอด, หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด เพื่อให้ความอบอุ่นในขณะดูแลรักษา

๓.๒ รถเข็นมีล้อเลื่อนขนาดใหญ่ ล้อคล้อยได้ ๔ ล้อ และมีราวจับเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๓.๓ ด้านล่างเตียงปฏิบัติการ มีตู้หรือลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ชั้น สำหรับเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็น

๓.๔ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๓๐ V +/- ๑๐%, ๕๐/๖๐ Hz

๓.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล IEC ๖๐๖๐๑-๑ : ๑๙๙๘, IEC ๖๐๖๐๑-๑-๒, IEC ๖๐๖๐๑-๒-๒๑, UL ๖๐๖๐๑-๑ : ๒๐๐๓ เป็นอย่างน้อย

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กสามารถให้พลังงานความร้อนโดยการแผ่รังสี เป็นแบบ calrod heater สามารถปรับพลังงานความร้อนได้ตั้งแต่ ๐-๕๕๐ วัตต์

๔.๒ มีส่วนควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor สามารถทำการตรวจสอบระบบการทำงานเองโดยอัตโนมัติหลังการเปิดเครื่องทุกครั้ง

๔.๓ มีแผงควบคุมการทำงาน (control panel) และจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิพร้อมไฟสัญญาณแสดงระดับการทำงานของระบบให้ความร้อน

๔.๔ ชุดแผงให้ความอบอุ่นสามารถปรับไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวาได้อย่างน้อย ๙๐° และดับโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการทำ X-Ray

๔.๕ มีหลอดไฟ LED ให้แสงสว่าง (Observation Light) เพื่อการส่องสว่างในการทำหัตถการบนตัวทารกแรกเกิดได้ง่ายขึ้น

๔.๖ มีชั้นวางของและเสาสำหรับแขวนถุงน้ำเกลือหรือสารน้ำต่างๆ ติดตั้งกับรถเข็นได้

๔.๗ มีสวิตช์ ปิด-เปิด เครื่อง (Power) และมีสวิตช์ควบคุม ปิด-เปิด แสงสว่างแยกออกจากกัน

๔.๘ เครื่องสามารถแผ่รังสีความร้อนสูงสุด ๑๐๐% ภายในเวลา ๑๒ นาที และสามารถลดระดับความร้อน คงที่ที่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของการแผ่รังสีสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมในการรอรับเด็ก

๔.๙ มีปุ่มเลือกใช้งานเพื่อควบคุมความร้อนได้ แบ่งเป็น ๒ Mode

๔.๙.๑ Manual Mode เป็นระบบแบบปรับเองโดยผู้ใช้งาน เพื่อปรับพลังงานความร้อนให้คงที่สามารถปรับได้ตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๔.๙.๒ Baby Mode เป็นระบบแบบปรับโดยอัตโนมัติจากผิวหน้าเด็ก สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๐ องศาเซลเซียส ถึง ๓๘ องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งได้เป็นตัวเลข และสามารถปรับอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ครั้งละ ๐.๑ องศาเซลเซียส



/๔.๑๐ พื้นเตียง...

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุลิพันธ์ ไชยพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๔.๑๐ พื้นเตียงปฏิบัติการมีแผ่น X-ray cassette tray อยู่ภายใต้เบาะรองรับเด็กที่แสงรังสีสามารถส่องผ่านได้

๔.๑๑ เตียงสามารถปรับเอียงได้อย่างน้อย $\pm 15^\circ$ ทั้งจากด้านหัวและด้านเท้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำหัตถการ

๔.๑๒ มีที่นอนทารก ขนาด $462 \times 640 \times 25.4$ mm. และมีที่กันป้องกันตัวเด็กทารกแรกเกิดตกเตียงอยู่ ๔ ด้าน สามารถดึงออกจากเตียงแล้วพับลงได้ง่ายอย่างน้อย ๑ ด้าน เพื่อความสะดวกในการให้การรักษายาบาลและง่ายต่อการทำความสะอาด

๔.๑๓ มีนาฬิกาจับเวลาแบบ Digital (Apgar timer)

๔.๑๓.๑ สามารถแสดงเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ ๑-๖๐ นาที

๔.๑๓.๒ มีเสียงเตือนทุกๆ ๑, ๕, ๑๐ นาที และเตือนทุก ๕ นาทีจนครบเวลา

๔.๑๔ มีระบบตัดไฟ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 40°C Heater จะตัดการทำความร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอุณหภูมิสูงนานเกินไป

๔.๑๕ มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ทั้งแสงและเสียงให้ทราบ ในกรณีต่อไปนี้

๔.๑๕.๑ เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Power failure alarm)

๔.๑๕.๒ เมื่อระบบภายในเครื่องขัดข้อง (System/Heater Failure Alarm)

๔.๑๕.๓ เมื่อ Probe ที่วัดอุณหภูมิชำรุดหรือขัดข้อง (Probe Failure/Disconnect Alarm)

๔.๑๕.๔ เมื่ออุณหภูมิที่ผิวหนังเด็กสูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ $\pm 1^\circ\text{C}$

๔.๑๕.๕ เมื่ออุณหภูมิที่ผิวหนังเด็กต่ำกว่า 30°C นานเกิน ๑๒ นาที

๔.๑๕.๖ เมื่อเครื่องให้ความร้อนมากกว่า ๒๕% นานเกิน ๑๒ นาที

๔.๑๕.๗ เมื่ออุณหภูมิที่ผิวหนังเด็กสูงกว่า 40°C

๔.๑๖ มีปุ่ม Alarm silence สำหรับกดปิดสัญญาณเสียงเตือน

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑	สายวัดอุณหภูมิผิวหนังเด็ก (Reusable Skin Temperature Probe)	จำนวน ๑ ชุด
๕.๒	Heat reflective patch (๕๐ชิ้น)	จำนวน ๑ กล่อง
๕.๓	เบาะรองรับเด็ก (Mattress Sheet)	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔	X-ray Tray	จำนวน ๑ ชุด
๕.๕	ชั้นวางและเสาสำหรับแขวนถุงน้ำเกลือ	จำนวน ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัท ผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖ มาแสดง

๖.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๖.๓ บริษัทฯ รับประกันคุณภาพการใช้งานเครื่องเป็นเวลา ๒ ปี

๖.๔ มีคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด



.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุลีพันธ์ ไชยพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

GE Healthcare

Lullaby Warmer

Because every baby deserves
a high standard of care



A confident choice for infant warming

At GE Healthcare, we share your commitment to providing high quality care for all newborns and infants. That's why we designed the new Lullaby™ Warmer with attention to the details that are essential to providing babies with a warm, comforting environment.





NOT COMMERCIALY AVAILABLE IN ALL MARKETS.
NOT CLEARED OR APPROVED BY THE U.S. FDA.




Exceptional Quality


The Lullaby Warmer helps you meet your high clinical standards and those of recognized experts in the field. Like all Lullaby products, it complies with certain internationally recognized clinical guidelines and regulatory requirements* for performance factors critical to the effectiveness of infant care. GE helps make high-quality infant warming accessible and affordable for virtually any healthcare facility.

Versatility, from L&D to NICU

By providing a stable, thermoregulated environment that enables fast, easy access to the baby, the Lullaby Warmer helps clinicians meet the requirements of different care areas, from newborns in Labor & Delivery to at-risk infants in the NICU.

* This product meets the international standards listed in the Regulatory Compliance section on the Specifications page of this brochure.

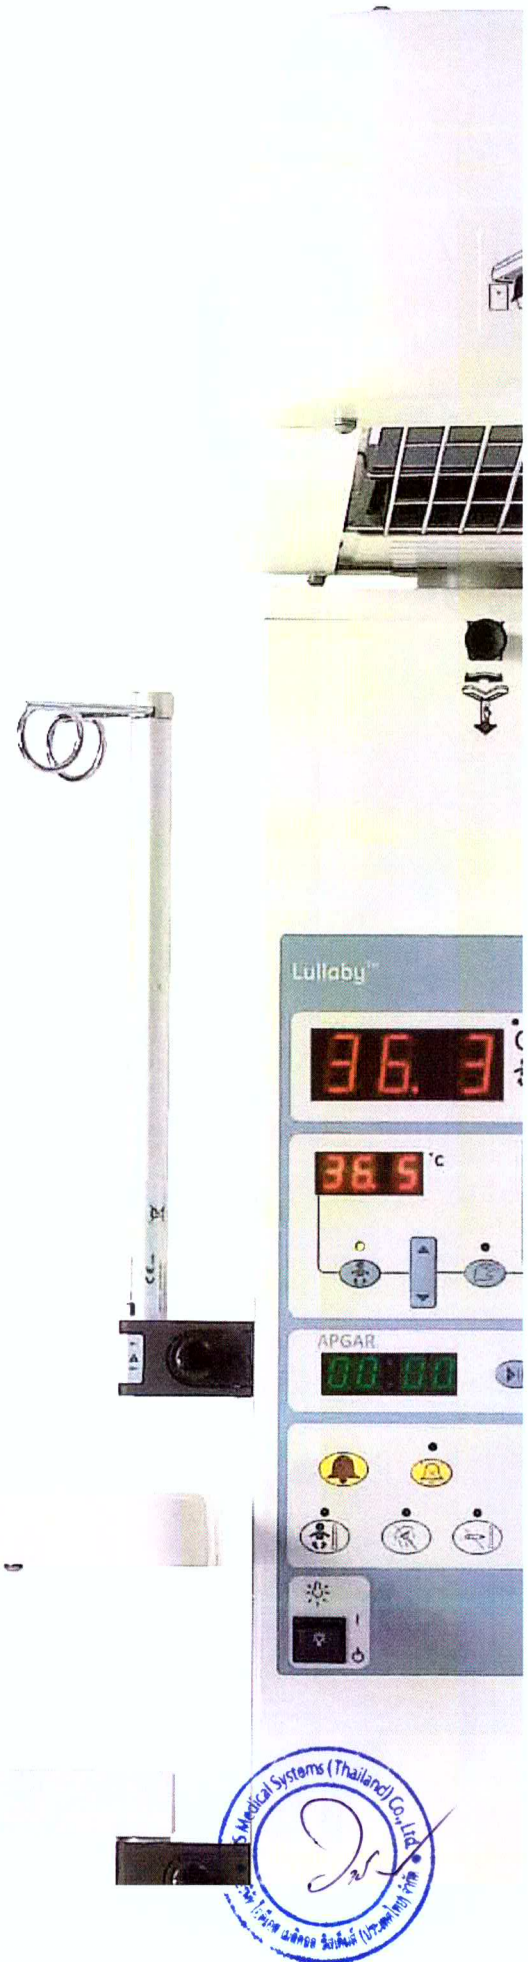

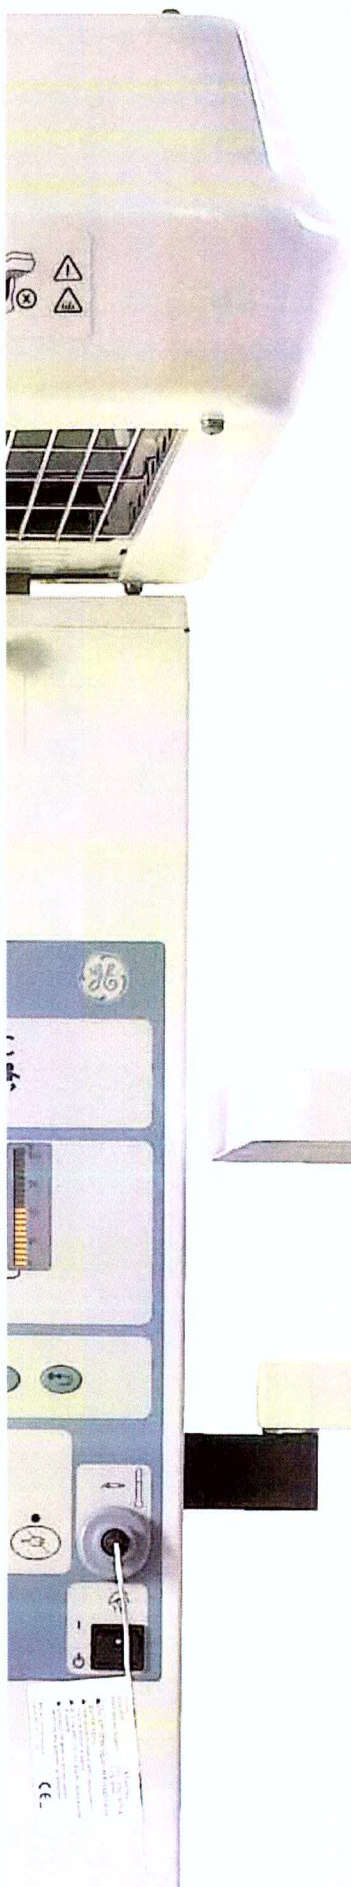

Create a cozy, thermo-stable environment

The micro-processor technology and intelligent engineering behind the Lullaby Warmer create a consistently warm bed for baby with built-in monitors that notify caregivers of critical temperature events.


- Warmer heats to 100% for 12 minutes, and then reduces to a steady 25% to maintain ready status. Heat adjustments can be made in 5% increments so you can fine-tune the warmth.
- Heat is evenly distributed via the Calrod® heater, which is precisely matched to the bed size.
- An innovative probe guard helps prevent the skin probe from becoming detached from the baby, helping reduce the risk of overheating due to lack of temperature monitoring.
- A “check baby” alarm sounds if baby’s skin temperature deviates by $\pm 1^{\circ}\text{C}$ from the set point. The unit stops heating if the temperature exceeds the desired value by 1°C , and restarts only when the temperature falls back into the 1°C range.



Concentrate on baby, not switches

The Lullaby Warmer is simple to use. System operation is intuitive, even for first-time users, and requires minimal training. Caregivers can concentrate on baby instead of worrying about switches and settings.


- Visually-coded control panel and color-coded safety alarms are simple to understand, no matter what the user's language.
- Large LED screen provides direct access to key functions and makes it easy to see and understand critical information.
- Well-positioned lights illuminate procedures and help reduce the need for external lighting and extra equipment.
- APGAR timer with audible tones at one, five, and ten minutes enables clinicians to concentrate on caring for the baby, rather than looking at the screen.

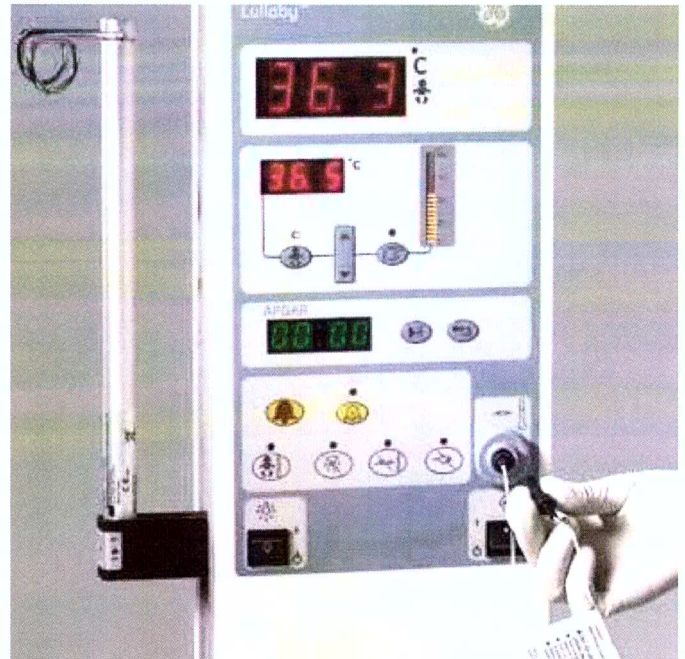

Provide efficient care

When caring for a newborn or sick infant, you need a warmer with exceptional clinical features. The Lullaby Warmer is designed to help make your procedures more effective and efficient.

- Smooth bed tilting of $\pm 15^\circ$ continuous positions optimizes clinical flexibility, especially during resuscitation.
- The heater module rotates 90° to either side to facilitate X-ray procedures. The heater automatically shuts off when in this position.
- An integrated X-ray tray below the mattress allows imaging without moving the infant.
- Sturdy dovetail rail system allows for easy and flexible mounting of accessories.
- Surfaces are designed for swift, thorough cleaning to support the infection control requirements of busy infant care areas.

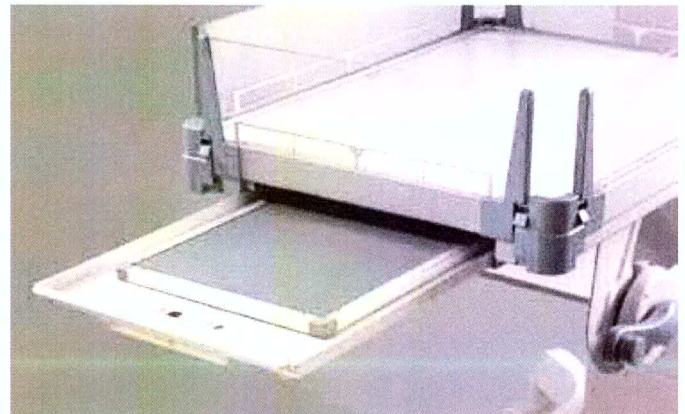

At your service

Like all GE Healthcare products, the Lullaby Warmer is backed by comprehensive service and support. This includes clinical training to optimize the skills and efficiency of your staff. You also can take advantage of our optional multi-year service coverage and extended service options. From training to service, GE Healthcare stands behind you to help ensure the long-term sustainability of your equipment investment.

About GE Healthcare

GE Healthcare provides transformational medical technologies and services that are shaping a new age of patient care. Our broad expertise in medical imaging and information technologies, medical diagnostics, patient monitoring systems, drug discovery, biopharmaceutical manufacturing technologies, performance improvement and performance solutions services help our customers to deliver better care to more people around the world at a lower cost. In addition, we partner with healthcare leaders, striving to leverage the global policy change necessary to implement a successful shift to sustainable healthcare systems.

Our "healthymagination" vision for the future invites the world to join us on our journey as we continuously develop innovations focused on reducing costs, increasing access and improving quality around the world.

Headquartered in the United Kingdom, GE Healthcare is a unit of General Electric Company (NYSE: GE). Worldwide, GE Healthcare employees are committed to serving healthcare professionals and their patients in more than 100 countries. For more information about GE Healthcare, visit our website at www.gehealthcare.com.

Recommended Accessories

Description	Part number
Standard Drawer Package (2 drawers) with Tray	2041342-001
IV Pole	2041600-001
Utility Pole	2041605-001
Monitor/Instrument Tray	2041616-001
Cylinder Holder	2041620-001
Reusable Temperature Probe	6600-0628-700
Disposable Temperature Probe, 10 Pack	6600-0208-700
Disposable Temperature Probe, 50 Pack	6600-0196-700
Heat Reflecting Patches, 50 Pack	0203-1980-300



Specifications

Dimensions

Height	1800 mm (with bed at lowest level)
Depth	1120 mm
Width	655 mm
Weight (excl. accessories)	72 kg
Mattress Size	462 x 640 x 25.4 mm
Bed to Floor Height	880, 950, 1020 mm (service adjustable heights)

Physical Characteristics

Heater Rotation	±90° to the side to facilitate X-ray procedures. The heater automatically shuts off when in this position.
Bed Tilt	±15° Trendelenburg and Reverse Trendelenburg, continuous tilt

System Control Characteristics

Manual Mode at power-up	
Microprocessor Based Control System	Self-test function performed at power - up and continuously during normal operation
Heater Output	0 – 540 W power adjustable from 0 - 100% in twenty 5% increments
Baby Control (Servo) Mode	30 - 38°C in increments of 0.1°C
Manual Mode	Indicates manual mode heat selection range from 0-100% in 5% increments
Temperature Measurement Accuracy	±0.3°C @ 30°C to 40°C
Temperature Display Resolution	±0.1°C

Temperature Probe Accuracy	±0.1°C @ 30°C to 42°C
Observation Light	50 W, 500 Lux at center of mattress; estimated lamp life 4000 hours

Operational Environment

Operating Temperature Range	+18 to +30°C
Humidity	30 to 75% RH

Storage Requirements

Temperature	-40° to 70° C
Humidity	10 to 95% RH (non-condensing)

Electrical Power Requirements

Power Requirements	230 V ± 10%, 50/60 Hz models; 4 Amps
Nominal Power Consumption	600 W max.

Complies with IEC 60601-1 for electrical safety

Regulatory Compliance

IEC Class 1 (continuous operation) and Type B

TUV certified to the following standards:

IEC 60601-1: 1998, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-21, UL 60601-1:2003, EMC Class-A, certified under IECCE CB scheme

Limited Warranty

One year parts and service
Lifetime warranty on heater rod

 GE Healthcare
8880 Gorman Road
Laurel, MD 20723
U.S.A.

Made in India
www.gehealthcare.com



© 2010 General Electric Company – All rights reserved.

General Electric Company reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. Contact your GE Representative for the most current information.

GE and GE Monogram are trademarks of General Electric Company.

Lullaby is a trademark of the General Electric Company.

Calrod is a registered trademark of the General Electric Company.

All other company and product names mentioned may be trademarks of the companies with which they are associated.

Datex-Ohmeda, Inc., a General Electric company doing business as GE Healthcare.

NOT COMMERCIALY AVAILABLE IN ALL MARKETS.
NOT CLEARED OR APPROVED BY THE U.S. FDA.





IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.
Lasalle Tower, Floor G/2, Floor 1-2, 10/11 Moo 16
Srinakarin Road, Bangkeaw, Bangphli, Samutprakarn 10540, Thailand
T : +66 2 349 4780 - 3
F : +66 2 758 8874; +66 2 758 8883
E : thainfo@idsMED.com
www.idsMED.com (Tax ID : 0105556093287)

ใบเสนอราคา / Quotation

เรื่อง เสนอราคา เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant warmer)		เลขที่ BKB06/650510-038
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี		วันที่ 10/5/65
สิ่งที่ส่งมาด้วย แค็ตตาล็อกพร้อมรายละเอียด		อ้างอิง
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้		
จำนวน	รหัสสินค้า	รายการ
1	เครื่อง	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant warmer) รุ่น Lullaby Warmer -Cartridge (Calrod*-like) technology for rapid warming -Micro-processor technology create a consistently warm bed for baby -Easy and intuitive with 2 Mode Selection Baby Mode from 30°C to 38°C in 0.1°C increments Manual Mode from 0 to 100% in 5% increments -X-ray cassette holder and a radioluscent mattress -APGAR timer with audible tones at one, five, and ten minutes -Smooth bed tilting of ±15° continuous positions optimizes clinical flexibility -Heater module rotates 90° to either side to facilitate X-ray procedures.
		หน่วยละ 300,000.00
		ราคารวม 300,000.00
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษสำหรับโรงพยาบาลบางพลีเท่านั้น		
		บริษัทฯ ยินดีลดราคาพิเศษ - 70,000.00
- รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี		ยอดสุทธิ 230,000.00
- กำหนดส่งของภายใน 120 วัน นับจากวันรับใบสั่งซื้อ		ราคาสินค้า 214,953.27
- กำหนดยื่นราคา 60 วัน นับจากวันเสนอราคา		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 15,046.73
- ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		ราคารวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 230,000.00
(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้		
ขอแสดงความนับถือ		
ในนามบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด		
ผู้เสนอราคา	นางสาววีรรัตน์ สุดสงวน	(นายสุโรจน์ พรหมวรานนท์)
	มือถือ : 096 934 2514	Director - Medical Specialty Care
ผู้ออกเอกสาร	นางสาวพรนภัส นัฏฐแก้ว	

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารลาซาลทาวน์ ชั้น G/2, ชั้น 1-2, เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 16 อ.ศรีนครินทร์, จ.บางพลี, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ 10540

T : +66 2 349 4780 -3, F : +66 2 758 8874; +66 2 758 8883, E : thainfo@idsMED.com

FP-SAL-01-02 Rev.00

Thailand





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาซื้อ)

เลขที่ 100052347267

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนศรีนครินทร์ กม.15 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 224/4-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดย น.ส.กรรณิการ์ มลิวัลย์ และ น.ส.เกษม มีสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ไอทีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant warmer) จำนวน 1 เครื่อง กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน 11,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จำนวนไม่เกิน 11,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.กรรณิการ์ มลิวัลย์)

(น.ส.เกษม มีสุวรรณ)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.ณัฐมนกาญจน์ สิงห์ชัย)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(น.ส.เมธาวี เป้าแบบดี)

พยาน



การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000167747-1 :-

EFF_C_2_NN_PLUS

Issued/Revised by K-CONNECT-LG
2403152

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315