

สัญญาซื้อขายระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ หัวจ่าย

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสกล สุขพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๙๙/๓-๕ หมู่ที่ ๙ ถนนประชาอุทิศ-คูสร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สป. ๐๐๐๐๘๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ AU-SV ๒๕๖๖/๐๔๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ หัวจ่าย จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๘๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๕,๐๘๔.๑๑ บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๓ (สาม)	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๖ (หก)	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

/ข้อ ๔. การส่งมอบ...

(ลงชื่อ).....**ส.**.....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....**กิตติยา ประเสริฐสิน**.....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญา พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

/ข้อ ๘. หลักประกัน...

(ลงชื่อ).....**ส.**.....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....**กิตติยา ประเสริฐสิน**.....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเทอร์มินอล ๒๑ พระราม ๓ เลขที่ ๐๖๘๕๑๐๐๐๐๓ QCM PG๒๑๙๕๐๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุโรปคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

/การคิดค่า...

(ลงชื่อ).....ส......ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ภูบัตริราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....กิติยา ประเสริฐสิน.....ผู้ขาย

(นางสาวกิติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ต้องชำระตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาดังกล่าว อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/ข้อ ๑๓. การใช้เรือ...

(ลงชื่อ).....**ส.**.....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....**ก้องว. ประสงค์สิน**.....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาเป็น สิ่งของของผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็น สิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายชล ธัญธริษตรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย

1. ความต้องการ

ชุดกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis) สำหรับผลิตน้ำบริสุทธิ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 GPD / 12,000 ลิตร เพื่อจ่ายให้กับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave) และการใช้งานทั่วไป

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดกรองน้ำบริสุทธิ์โดยใช้ระบบ RO (Reverse Osmosis) เพื่อจ่ายให้กับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave) และการใช้งานทั่วไป สามารถรองรับจ่ายน้ำให้กับเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 จุด

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

3.1 เครื่องกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis)

3.1.1 ระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis มีโครงสร้างตัวเฟรมเป็นสแตนเลส คุณภาพสูงเกรด 304 แข็งแรงทนทาน และมีการเดินระบบต่าง ๆ ภายในด้วยท่อ UPVC อย่างดี

3.1.2 มีขนาดกำลังการผลิตน้ำบริสุทธิ์ได้ไม่น้อยกว่า 3000 GPD / 12,000 ลิตร ต่อวัน

3.1.3 มีอัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ต่อชั่วโมง และมีค่าการนำไฟฟ้าของน้ำบริสุทธิ์ไม่มากกว่า 30 ไมโครซีเมนส์

3.1.4 มีไส้กรองเมมเบรนเป็นชนิด Thin Film Composite ผลิตจากวัสดุ Polyamide (Pa) มีความละเอียด 0.0001 ไมครอน

3.1.5 ครอบปกป้องไส้กรอง RO (Shelter) ทำจากสแตนเลส มีความแข็งแรงและสามารถทนแรงได้

3.1.6 มีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP ขนาด 5 ไมครอน จำนวน 1 ท่อน

3.1.7 มีมาตรวัดแรงดันส่วนที่ต้องสัมผัสกับน้ำวัสดุทำด้วยเหล็กไร้สนิมแบบมีน้ำมันบรรจุ

3.1.8 มีชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ อย่างน้อย 2 ชุด



3.1.8.1 ชุดวัดอัตราการไหลของการผลิตน้ำ RO จำนวน 1 ชุด

3.1.8.2 ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำทิ้ง จำนวน 1 ชุด

3.1.9 มีตู้คอนโทรลสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง

3.1.9.1 ตู้ควบคุมทำด้วยเหล็กเคลือบสีหรือสแตนเลส มีประตูสำหรับเปิดปิดและมีขนาดตามความเหมาะสม

- 3.1.9.2 มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานต่าง ๆ เช่น ไฟการทำงานของเครื่องกรอง RO ไฟแสดงสภาวะผิดปกติต่าง ๆ
- 3.1.9.3 มีปั๊มเซอร์ (ดังเป็นจังหวะ) สำหรับแจ้งเตือนสภาวะผิดปกติต่าง ๆ
- 3.1.9.4 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สำหรับแสดงค่าต่าง ๆ ที่วัดได้ เช่น ค่าความกระด้างของน้ำ (TDS Meter) ที่ออกจากตัวเครื่อง, ค่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Conductivity Meter) ฯลฯ
- 3.1.9.5 มีอุปกรณ์ตัดการทำงานของระบบเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลตามขนาดที่เหมาะสม
- 3.1.10 มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงให้สัมพันธ์กับการใช้น้ำแบบอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันเครื่องสูบน้ำเสียหายกรณีที่น้ำดิบมีปัญหา และมีสัญญาณเตือนแบบแสงและเสียงพร้อมสวิตช์รีเซต (Over Load) ที่เมกเนติก
- 3.1.11 มีระบบเพรชเซอร์สวิตช์ เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำในกรณีที่แรงดันน้ำต่ำกว่าระบบ RO ที่กำหนด โดยการตัดกระแสไฟที่จ่ายให้ พร้อมส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุมเพื่อแจ้งสถานะให้ทราบ
- 3.1.12 มีเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงชนิดหลายใบพัด แบบแนวตั้ง เพื่อสูบน้ำจ่ายเข้าระบบกรองแบบ RO (Reverse Osmosis) ใบพัดทำด้วยเหล็กไร้สนิม ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 20 Hz จำนวน 1 ชุด
- 3.1.13 มีวาล์วสำหรับควบคุมน้ำเข้าอัตโนมัติ (Solenoid Valve) ซึ่งปิดเปิด โดยใช้ระบบไฟฟ้า เมื่อระบบต้องการน้ำ
- 3.1.14 มีวาล์วควบคุมการไหลของน้ำที่จะทิ้งออกจากระบบ
- 3.1.15 ระบบน้ำ RO สามารถจ่ายน้ำให้กับเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 จุด
- 3.2 ชุดเก็บถังน้ำ**
- 3.2.1 ถังเก็บน้ำมีขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ทำด้วยโพลีเอทิลีน หรือ สแตนเลส
- 3.2.1.1 ถังพักน้ำประปา ทำจากโพลีเอทิลีน หรือ สแตนเลส จำนวน 1 ถัง
- 3.2.1.2 ถังพักน้ำอ่อน ทำจากโพลีเอทิลีน หรือ สแตนเลส จำนวน 2 ถัง
- 3.2.1.3 ถังพักน้ำ RO ทำด้วยโพลีเอทิลีน หรือ สแตนเลส จำนวน 3 ถัง
- 3.2.2 ลักษณะถังเป็นระบบปิด ฝาถังขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวไร้รอยต่อ ด้านล่างถังเป็นชนิดกับกรวยมีท่อน้ำออก โดยต่อจากทางด้านล่างสุดของถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำขังในถัง
- 3.2.3 มีรูสำหรับต่อน้ำเข้าและน้ำออกขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว

1. 
 2. 
 3. 
 4. 

คิดไป ประสงค์สุคนธ์

คิดไป ประสงค์สุคนธ์

3.2.4 มีสวิตช์ลูกกลอยไฟฟ้า (Level Switch Control) ควบคุมการทำงานอัตโนมัติเฉพาะชุดถังพักน้ำ RO
 อย่างน้อย 2 ระดับ

3.2.4.1 ระดับน้ำเต็มถึง สั่งให้เครื่องผลิตหยุดการทำงาน (High Stop)

3.2.4.2 ระดับน้ำต่ำ สั่งให้เครื่องผลิตน้ำทำงาน (Low Start)

3.3 ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน

3.3.1 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 Hz มีขนาดกำลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์ จำนวน 6 ตัว

3.3.2 มีอัตราความเร็วรอบของปั๊มไม่น้อยกว่า 2,800 รอบต่อนาที

3.3.3 สามารถสร้างแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 บาร์

3.3.4 มีตู้คอนโทรลสลับปั๊ม จำนวน 3 ตู้

3.4 ชุดถังกรองพร้อมสาร

3.4.1 เป็นถังกรองน้ำ Fiber FRP Tank ขนาดของถังความจุ 69 ลิตร พร้อมหัวอัตโนมัติจำนวน 3 ถัง ภายใน
 บรรจุด้วยสารแมงกานีส, สารเรซิน มีความจุไม่น้อยกว่า 35 ลิตร

3.4.2 มีถังพักน้ำเกลือสำหรับไว้ล้างสารกรองเรซิน

3.4.3 สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 150 PSI

3.4.4 ให้อัตราการไหลผ่านของน้ำไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ต่อชั่วโมง

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับของครบ (ไม่
 รวมไส้กรอง RO ภายในเครื่องที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง)

4.2 เครื่องที่ส่งมอบจะต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4.3 ในระยะประกันหากเครื่องขัดข้อง บริษัทฯ ต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4 บริษัทฯ ต้องบริการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดอายุการประกัน

4.5 บริษัทฯ ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญมาทำการสาธิตการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่
 โรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

ชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....


nam
 NAMWATT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
nam
 NAMWATT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

nam^o

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited (Head Office)
 999/3-5 Moo 9 Prachautit-Kusang Rd., Naiklongbangplakod,
 Phrasamut Chedi, Samutprakorn 10290 Thailand
 ☎ +66 2461 7287-90 ☎ +66 2461 7291
 TAX ID : 0107565000654 • www.namwiwat.com

Model No. RO 3000G -20S

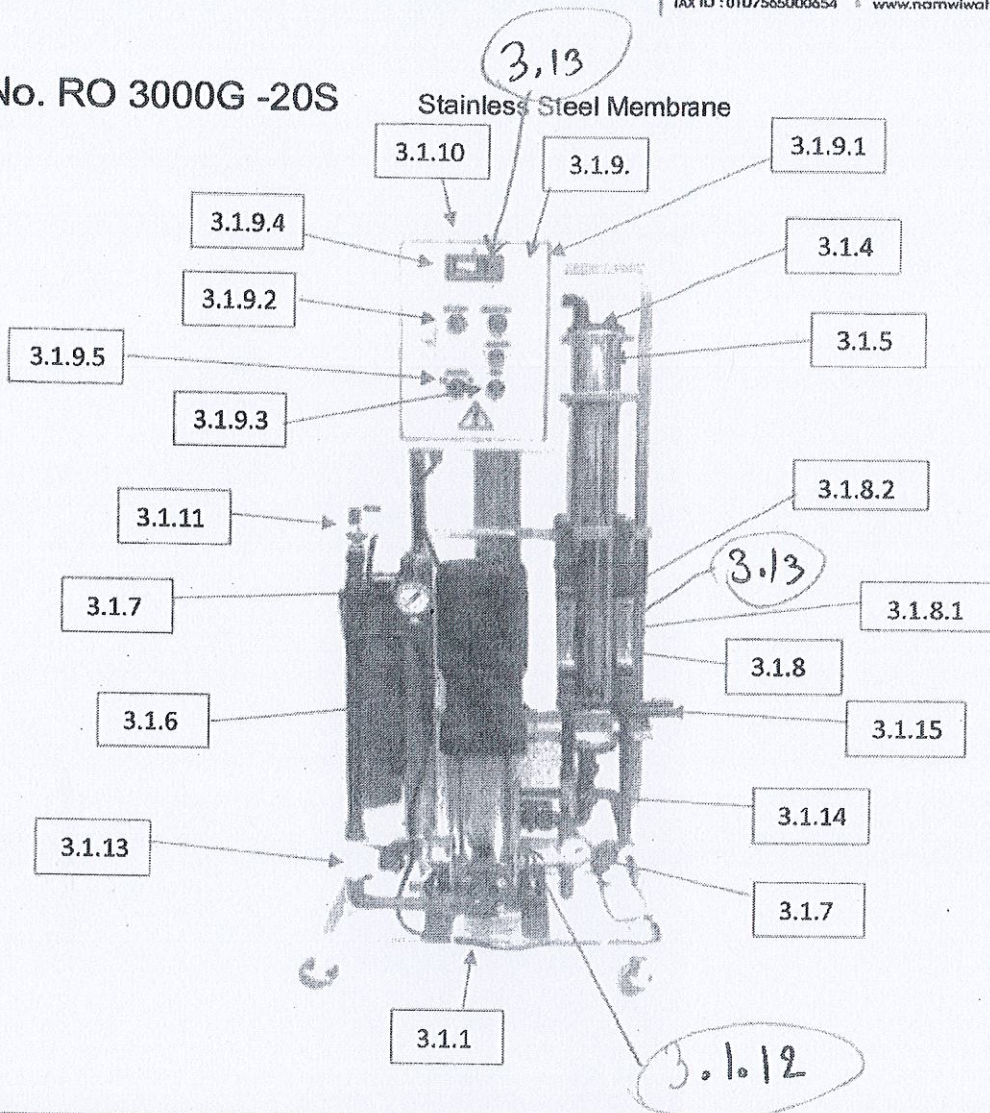

Pure-water Out-Put	3000GPD ← 3.1.2
RO-Membrane	4040x2 Membrane Brend Option:Hidrotek
Pump power	1.5KW
Recovery	29%
Filter	20"PP 5μ m & CTO
Display	Total Dissolved Solids (TDS)PPM
Voltage	220V,50/60Hz,1PHASE
Controller	Automatic Controller
Pressure Gauge	Source-inlet & HP Pump pressure & RO Concentrate
Dimention (LxWxH)	62x53x162

nam^o
 NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED


nam^o
 NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

ACCESSORIES

SPIMXMT013	220/50	1100	2860	14	232	116	30	20	40	21
------------	--------	------	------	----	-----	-----	----	----	----	----

3.3.2

Model No. RO 1500 - 4500G -20S

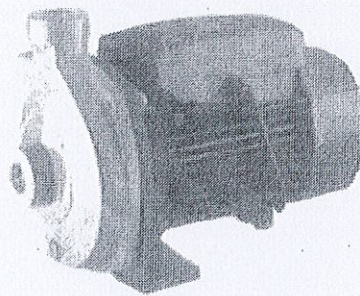

3.3.1

WATER PUMP



3.3.4


NMF56F

nam°

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited (Head Office)
 999/3-5 Moo 9 Prachautit-Kusang Rd., Nolkongbangplakod,
 Phrasomut Chedi, Samutprakarn 10290 Thailand
 ☎ +66 2461 7287-90 ☎ +66 2461 7291
 TAX ID : 0107565000654 • www.namwiwat.com

Item No.	Controller Mode	Pressure	Temperature	Maximum Water Output	Filter Tank Diameter	Water inlet/outlet	Drain	Center pipe	Base
NMF71B	Time/PTC	0.1-0.6Mpa	5 - 45 (°C)	2T/H	6 -14"	3/4"external thread	3/4"external thread	1.05"	2 -1/2"


Auto - Filter Valve

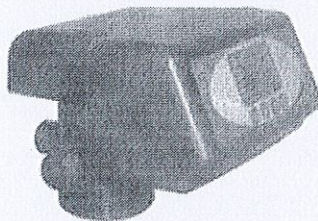

NMF71B

Item No.	Controller Mode	Pressure	Temperature	Maximum Water Output	Filter Tank Diameter	Water inlet/outlet	Drain	Salt absorb	Center pipe	Base
NMF63C3	Time/Flume regeneration	0.1-0.6Mpa	5 - 45 (°C)	4.5T/H	6 -18"	1" external thread	1/2" internal thread	3/8 external thread	1.05"	2 -1/2"

Auto – Soften Valve

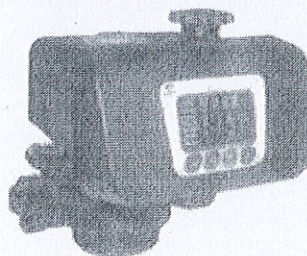

NMF63C3

✓
 2
 3
 4


ชื่อ นามวิวัฒน์

nam°
 NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ นามวิวัฒน์

nam°
 NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

ACCESSORIES

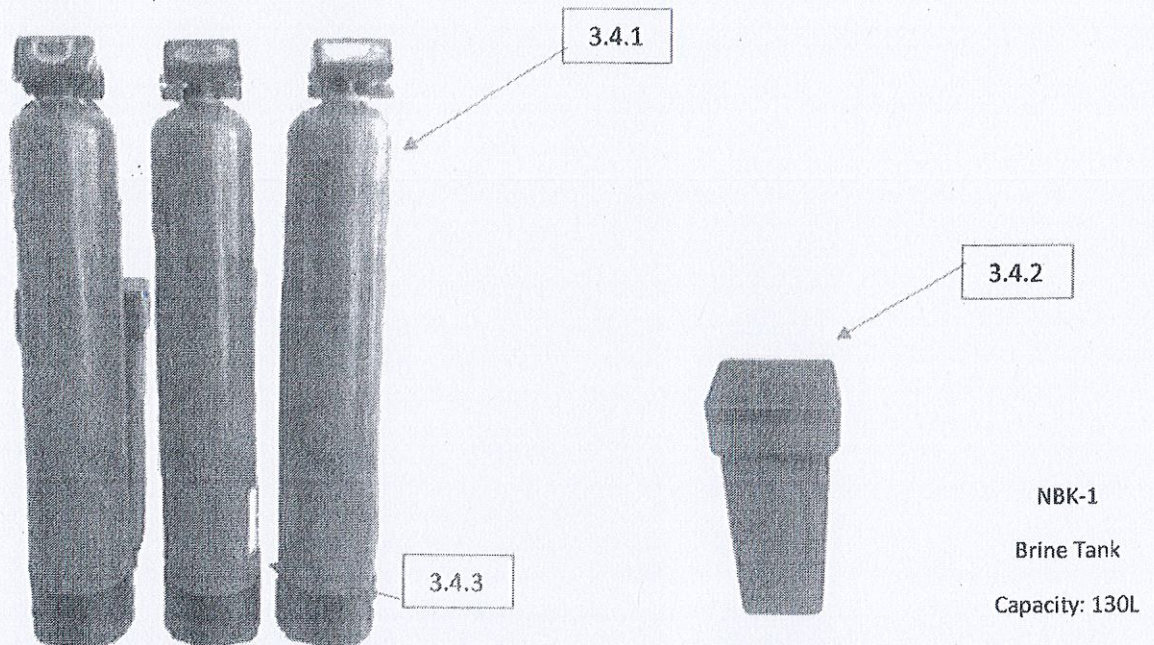


Item No.	Control Valve Item No		Water Out - put (T/H)	Inlet/Out- put Size (inch)	Vessel Size *Nos.	Resin (Liter/Kgs)	Active Carbon (Liter/kgs)	Manganese (Liter/kgs)	Brine Tank *Nos.
	Soften Type	Filtration Type							
Nam -1-T	NMF63C3 *1	NMF71B*2	500-1200	1"-3/4	250x1380*3	50	25	50	130L*1
Nam -2-T	NMF63C3 *1	NMF71B*2	1000-2000	1"-3/4	300x1330*3	70	35	70	130L*1
Nam -3-T	NMF63C3 *1	NMF67B*2	1800-2500	1"	325x1390*3	85	42	85	130L*1
Nam -4-T	NMF63C3 *1	NMF67B*2	2000-3000	1"	350x1660*3	120	60	120	130L*1
Nam -5-T	NMF63C3 *1	NMF67B*2	2500-4500	1"	400x1660*3	155	75	155	130L*1
Nam -6-T	NMF63C3 *1	NMF67B*2	3000-5000	1"	530x1560*3	290	145	290	180L*1

3.4.4

Size		Diameter (mm)	Height		Top open	Bottom open	Liter	Media-Liter	Flow (liter/hour)
In	mm		With Base	Without Base					
10*54 (EA)	250x1380	257	1400	1370	2.5"	/	69	48-52	500-1200
12*52 (EA)	300x1330	308	1355	1320	2.5"	/	96	67-72	1000-2000
13*54 (EA)	325x1390	334	1400	1370	2.5"	/	117	82-88	1800-2500
14*65 (EA)	350x1660	358	1665	1610	2.5"	/	164	114-123	2000-3000
16*65 (EA)	400x1660	405	1665	1640	2.5"	/	214	149-160	2500-4500
21*62 (EA)	530x1560	545	1840	1600	4"	4"	344	274-293	3000-5000

ACCESSORIES

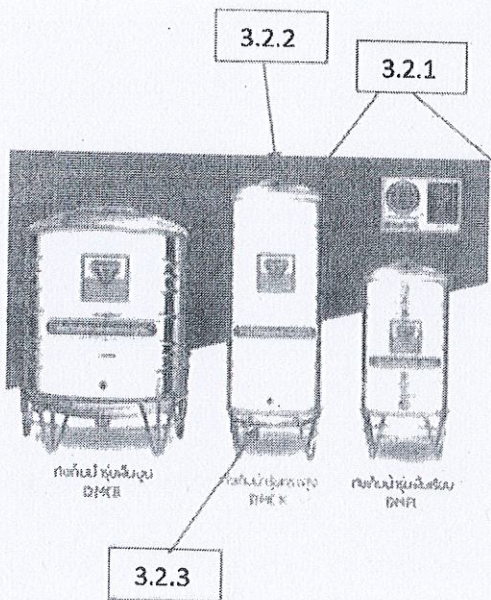

ถังเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพา รุ่นพกพา DMCX

ถังเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพา	ขนาดถังเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อ (ลิตร)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ความสูงรวม (มม.)	ความสูงถังเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อ (มม.)	ความกว้าง (มม.)	การปล่อยน้ำยาฆ่าเชื้อ (ลิตร/ชม.)	การปล่อยน้ำยาฆ่าเชื้อ (ลิตร/ชม.)
DMCX 750	750	0.73	2.22	0.35	2.47	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCX 1000	1000	0.91	1.88	0.35	2.11	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCX 2000	2000	1.11	2.52	0.35	2.72	Ø 3/4"	Ø 1"

ถังเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพา รุ่นพกพา DMCB

ถังเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพา	ขนาดถังเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อ (ลิตร)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ความสูงรวม (มม.)	ความสูงถังเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อ (มม.)	ความกว้าง (มม.)	การปล่อยน้ำยาฆ่าเชื้อ (ลิตร/ชม.)	การปล่อยน้ำยาฆ่าเชื้อ (ลิตร/ชม.)
DMCB 350	350	0.59	1.45	0.35	1.71	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCB 500	500	0.73	1.49	0.35	1.74	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCB 750	750	0.91	1.53	0.35	1.76	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCB 1000	1000	1.11	1.36	0.35	1.56	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCB 1250	1250	1.11	1.59	0.35	1.79	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCB 1500	1500	1.39	1.38	0.35	1.57	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCB 2000	2000	1.39	1.61	0.35	1.80	Ø 3/4"	Ø 1"
DMCB 2500	2500	1.39	1.99	0.35	2.18	Ø 3/4"	Ø 2"
DMCB 3000	3000	1.39	2.35	0.35	2.54	Ø 3/4"	Ø 2"
DMCB 4000	4000	1.53	2.73	0.50	2.99	Ø 3/4"	Ø 2"
DMCB 5000	5000	1.53	3.27	0.50	3.52	Ø 3/4"	Ø 2"
DMCB 6000	6000	1.53	3.90	0.50	4.15	Ø 3/4"	Ø 2"
DMCB 10000	10000	2.23	3.05	0.50	3.37	Ø 3/4", 2"	Ø 3"
DMCB 15000	15000	2.23	4.39	0.50	4.71	Ø 3/4", 2"	Ø 3"


กิตติกร ประจักษ์กุล

nam^o
 NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

กิตติกร ประจักษ์กุล

nam^o
 NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

Handwritten signature and stamp area.

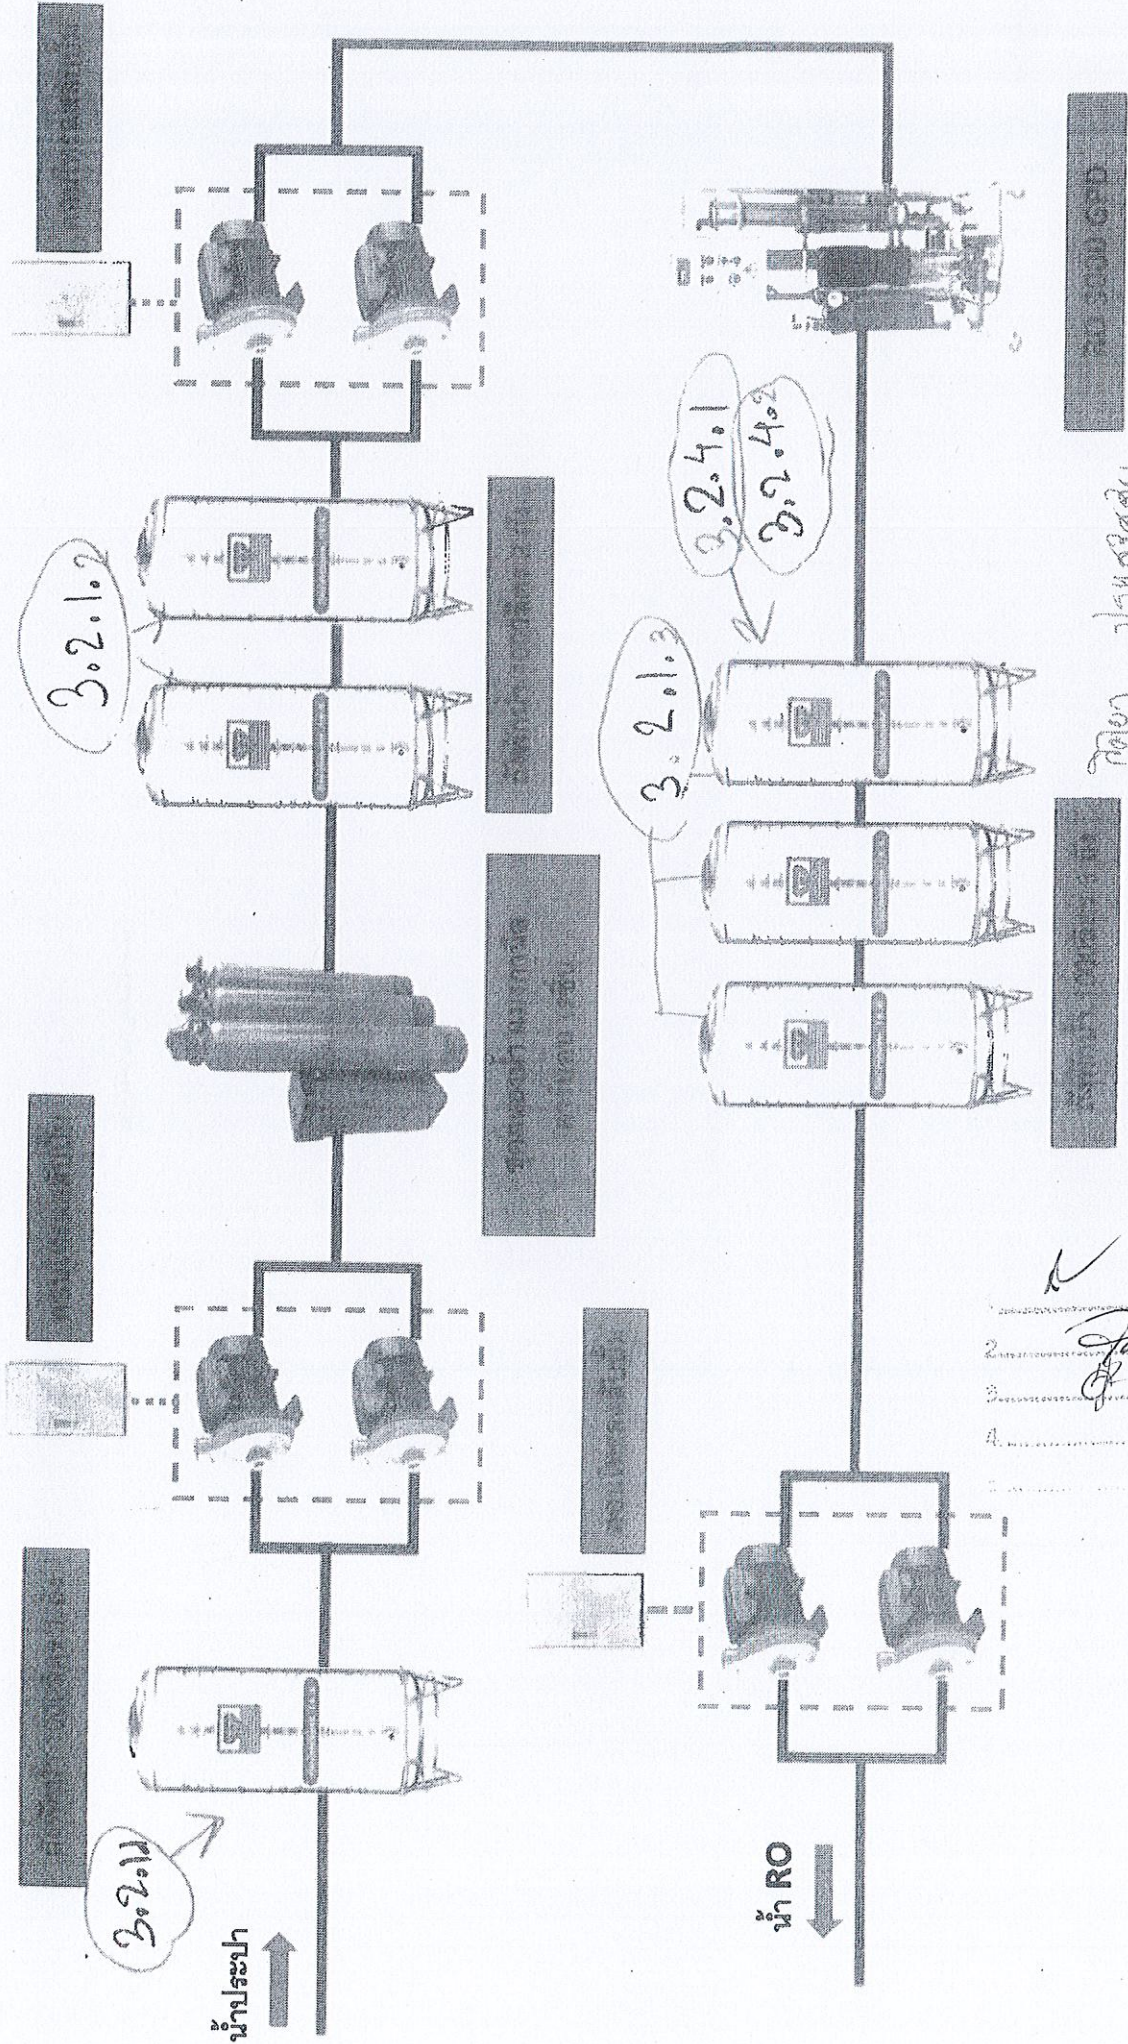

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๙๙๙/๓-๕ หมู่ที่ ๙ ถนน ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ตำบล ในคลองบางปลา กต อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๔๔๖๓๙๖ โดย นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบ จ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ หัวจ่าย	-	-	๑ เครื่อง	๘๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
๒	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลิตร	-	-	๑ เครื่อง	๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
๓	เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติ พร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร	-	-	๑ เครื่อง	๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
๔	เครื่องฆ่าเชื้อและกำจัดฝุ่น ละอองในอากาศชนิดไร้แผ่น กรองขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	-	-	๒ เครื่อง	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๕,๐๕๗,๐๐๐.๐๐	

(ห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้
เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด
ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่านี้นี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

พิศุภา ประเสริฐสิน
(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ใบเสนอราคาเลขที่ 6602160027965

รหัสอ้างอิง OTP tSum

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๖๕๐๐๐๖๕๔

nam^o
NAMWIAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

2. ใบเสนอราคา
3. ใบเสนอราคา
4. ใบเสนอราคา



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)

(กรณีปกติ)

เลขที่ 06851000003 QCMPG219508

วันที่ 5 เมษายน 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 356 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพัฒนจิตา งามวิทยานนท์ และ นายวุฒิพร ชัยยืน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท นาวีวัฒน์ เมคคอลลอรี่พรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาซื้อขายระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัวจ่าย จำนวน 1 เครื่อง กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่..... ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน 42,100.00 บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จำนวนไม่เกิน 42,100.00 บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

.....
(นางสาวพัฒนจิตา งามวิทยานนท์ นายวุฒิพร ชัยยืน)

.....พยาน
(นางสาวธัญลักษณ์ พรหมปัญญา) (นายภาณุพงศ์ เลิศโรตง)