

สัญญาซื้อขายเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลิตร

สัญญาเลขที่ ๘๖ / ๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสกล สุขพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๙๙/๓-๕ หมู่ที่ ๙ ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สป. ๐๐๐๑๒๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ AU-SO๒๕๖๖/๒๑๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลิตร จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๘,๕๐๔.๖๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๓ (สาม)	หน้า
๓.๒ ผผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๑๙ (สิบเก้า)	หน้า
๓.๓ ผผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

/ข้อ ๔. การส่งมอบ...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

/ข้อ ๘. หลักประกัน...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเทอร์มินอล ๒๑ พระราม ๓ เลขที่ ๐๖๘๕๑๐๐๐๐๓ QCM PG๒๑๙๕๐๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเติมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

/การคิดค่า...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบโดยอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/ข้อ ๑๓. การใช้เรือ...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....**ก.**.....ผู้ซื้อ

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

nam^o
NAMWIAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....**กิตติยา ประเสริฐสิน**.....ผู้ขาย

(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ).....**สาวยล ธัญญะศิริ**.....พยาน

(นางสาวสาวยล ธัญญะศิริ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....**ปาริชาติ มงคลเสริม**.....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาด 650 ลิตร
 ยี่ห้อ NAMWIIWAT รุ่น WH650 ผลิตภัณฑประเทศไทย

1. ความต้องการ

เครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุของห้องล้าง 650 ลิตร ชนิด 2 ประตู

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้เพื่อล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 เป็นเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบน้ำเย็น, น้ำร้อนและมีระบบอบแห้งในตัว ทำงานโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการทำงาน ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
- 3.2 ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีลเป็นแบบตู้ตั้งพื้นมีขนาดความจุของห้องล้าง 650 ลิตร แบบ 2 ประตู
- 3.3 มีระบบทำน้ำร้อนภายในตัวเครื่อง เพื่อใช้ในขั้นตอนการล้าง
- 3.4 ควบคุมโปรแกรมการทำงานของเครื่องด้วยระบบ Microprocessor แบบอัตโนมัติ
- 3.5 ใช้ไฟฟ้า 380-400 โวลต์ 50 Hz 3 เฟส 4 สาย

4. คุณลักษณะทางเทคนิค

- 4.1 ภายในห้องล้าง มีขนาดความจุของห้องล้าง 650 ลิตร ทำจากสแตนเลสสตีล เกรด AISI 316L และส่วนประกอบฝาปิดตัวเครื่องด้านนอกทำด้วยสแตนเลสสตีล
- 4.2 ภายในห้องล้าง (Washer Chamber) มีใบพัดสำหรับฉีดชำระล้างแบบหมุน เพื่อให้สามารถล้างได้อย่างทั่วถึง โดยอยู่ส่วนบน และส่วนล่างของห้องล้าง และระหว่างชั้นบรรจุตะกร้า
- 4.3 ตัวเครื่องมีประตูเปิดปิด 2 ประตู ประตูเป็นแบบเปิดสไลด์เลื่อนขึ้นลง ในแนวตั้ง บริเวณ ด้านหน้าประตูมีกระจกใสสามารถทนความร้อน สามารถมองเห็นภายในห้องล้างขณะเครื่องทำงานได้
- 4.4 สามารถเลือกโปรแกรมการล้างและทำลายเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 30 โปรแกรม เพื่อความเหมาะสมในแต่ละโปรแกรม จะมีการล้างด้วยน้ำเย็นและน้ำร้อน


- 4.5 ระบบปั้มน้ำหมุนเวียน (Circulation Pump) จำนวน 1 ปั้ม
 - 4.6 ระบบปั้มน้ำดูดน้ำยาเคมีที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปั้มและมีถังบรรจุน้ำยาสำหรับใช้ในการชำระล้างถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ถัง
 - 4.7 มีระบบตรวจสอบอุณหภูมิในห้องนี้ (Double Temperature Checked) เพื่อป้องกันการผิดพลาดของอุณหภูมิ
 - 4.8 มีระบบป้องกันภัย ไม่ให้ประตูเปิดในขณะที่เครื่องทำงาน โดยจะล็อก ถ้าปิดประตูไม่สนิทเครื่องจะไม่สามารถเริ่มทำงานได้ และมีสัญญาณแสดงให้ผู้ใช้งานทราบ
 - 4.9 มี Plasma ozone สำหรับระบบการฆ่าเชื้อในอากาศที่จะผ่านเข้ามาในห้องล้างในกระบวนการเป่าแห้ง
 - 4.10 มีหลอดไฟส่องสว่างภายในห้องล้างซึ่งจะสามารถเปลี่ยนสีตามขั้นตอนการล้าง
 - 4.11 ประตูเป็นระบบโซ่ดึงฝาประตูผ่านมอเตอร์ขึ้นลงในแนวดิ่ง
5. ระบบควบคุมการทำงาน
- 5.1 ตัวเครื่องถูกควบคุมด้วยระบบ Microprocessor รายงานผลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch screen) ติดตั้งเป็นแนวขวางมีระบบ Software ที่สามารถอ่านโปรแกรม และอ่านค่าต่างๆ ที่สำคัญได้จากหน้าจอเครื่องโดยหน้าจอภาพรายงานผลเป็นภาษาไทย สามารถแสดงสถานะต่างๆ ขณะที่เครื่องทำงานให้ทราบดังนี้
 - 5.1.1 โปรแกรมการทำงานในแต่ละช่วง
 - 5.1.2 โปรแกรมที่เลือก
 - 5.1.3 อุณหภูมิของน้ำ ในห้องล้าง
 - 5.1.4 เวลาการทำงาน
 - 5.1.5 ความผิดปกติของระบบ
 - 5.2 ในขณะที่เครื่องทำการล้างและฆ่าเชื้อหากมีข้อผิดพลาดหรือขัดข้อง เครื่องจะหยุดทำงานและมีเสียงสัญญาณเตือนและควบคุมการทำงานของเครื่องจะแสดง Fault Code บอกสาเหตุที่เครื่องทำงานผิดปกติบนหน้าจอเครื่อง
6. อุปกรณ์ประกอบ
- 6.1 รถเข็นสำหรับเข็นของเข้าห้องล้าง
 - 6.2 ชุดตะกร้าสำหรับบรรจุภาชนะเข้าห้องล้าง

✓
 2
 3
 4
 5

จำนวน 2 คัน


กิลดา ปานกรวิเศษ จำนวน 1 ชุด

- | | |
|--|---------------|
| 6.3 ตะกร้าสำหรับบรรจุของเข้าห้องล้าง | จำนวน 10 ใบ |
| 6.4 น้ำยาสำหรับการล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ | จำนวน 20 ลิตร |
| 6.5 เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ให้เป็นน้ำอ่อนแบบอัตโนมัติ (RO) | จำนวน 1 ชุด |
| 6.6 ถังพักน้ำสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร | จำนวน 1 ใบ |
7. เงื่อนไขเฉพาะ
- 7.1 ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานยี่ห้อที่เสนอโดยตรง (Original product) ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่จ้างโรงงานอื่นผลิตให้ (OEM.)
- 7.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO13485:2016 , ISO14001:2015 จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- 7.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASME และ PED
- 7.4 ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ชำนาญการที่สามารถดูแลรักษาเครื่องได้จากบริษัทผู้ผลิต
- 7.5 เครื่องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 7.6 มีคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด
- 7.7 รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี โดยบริการหลังการรับมอบพร้อมอะไหล่ฟรี 1 ปี และผู้ขายจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างน้อย 4 ครั้ง / ปี
- 7.8 ผู้ขายจะต้องสาธิตแนะนำการใช้เครื่องและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้เครื่องและอบรมบำรุงรักษาเครื่องให้แก่ช่างโรงพยาบาล

1. 
 2. 
 3. 
 4. 

กิตติกร ปานศรีสุจิน

nam°

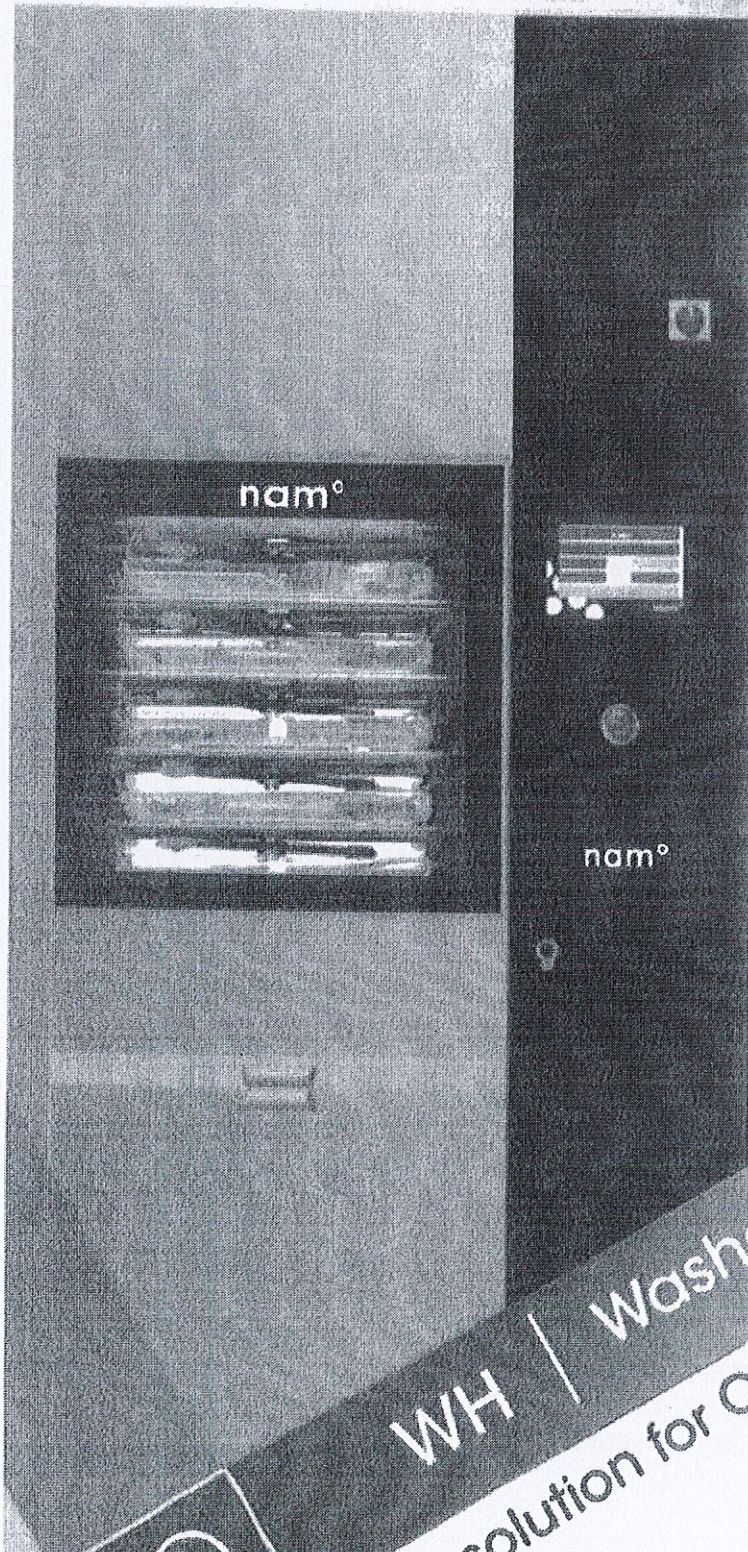

WH | Washer Disinfectors
Total solution for CSSD - systems Automations

1. Design and development of the system
2. Installation and commissioning
3. Training of staff
4. Maintenance and repair services
5. Spare parts supply

નોંધ પ્રાપ્ત કરો

LEADING TECHNOLOGY FOR LIFE

NAMWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

નોંધ પ્રાપ્ત કરો

nam°

NAMWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

Washer Disinfectors


Namwivat พัฒนาเครื่องล้างฆ่าเชื้อรุ่น WH 650 ที่มีความสามารถในการล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง (Alkaline) การทำลายเชื้อโรคด้วยความร้อน (Thermal disinfection) และการเป่าแห้ง (Drying) เครื่องมือฆ่าเชื้อและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ โดยสามารถรองรับภาชนะบรรจุ (DIN) สูงสุด 18 ภาชนะ เครื่องล้างฆ่าเชื้อรุ่น WH650 ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการในการล้างและทำปราศจากเชื้อของ CSSD สมัยใหม่ เพิ่มความสามารถพิเศษไปอีกระดับด้วยระบบ HEPA filter และพลาสมา ไอโซน (plasma ozone) เพื่อกรองและฆ่าเชื้ออากาศในกระบวนการเป่าแห้ง ช่วยป้องกันการกระจายอากาศที่ปนเปื้อนในทุกระยะของห้องล้างและภาชนะบรรจุ ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือฆ่าเชื้อและวัสดุทางการแพทย์จะแห้งสะอาดทั้งภายในและภายนอก

มีให้เลือกทั้งแบบประตูเดี่ยวหรือสองประตู รุ่น WH 650 ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงวิศวกรของบริษัทนำวิวัฒน์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าเครื่องล้างฆ่าเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ โดยผลิตภายใต้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม (ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 15883-2: 2006, การบันทึกด้วยรถขึ้น คำนึงถึงความสูงตามหลักสรีรศาสตร์ของผู้ใช้งาน (ergonomic) การประหยัดน้ำและพลังงานรวมทั้งการใช้พลังงานแบบหมุนเวียน

Model: WH

Washer Disinfectors

Total solution for CSSD

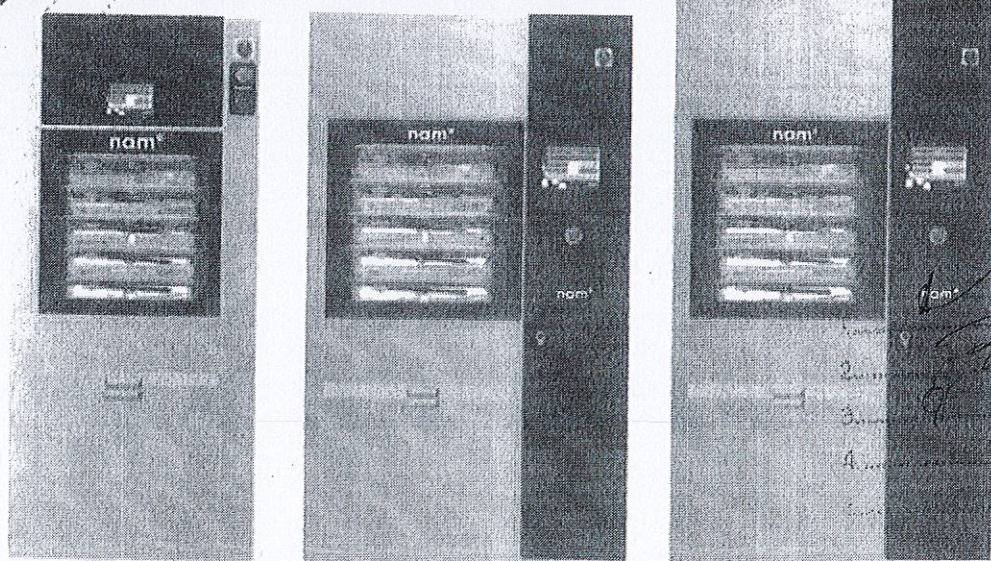

Available for single and double doors

nam^o


NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

999 3-5 Moo 9, Pracha Uthit -Khu Sang Rd. Naiklongbangplakod, Phra Samut Chedi District,
Samut Prakan 10290, Thailand

Phone +662 461 7287-9, Fax +662 461 7291

Washer
Disinfector

Technical specification คุณสมบัติทางเทคนิค
Washer Disinfector เครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์อัตโนมัติ

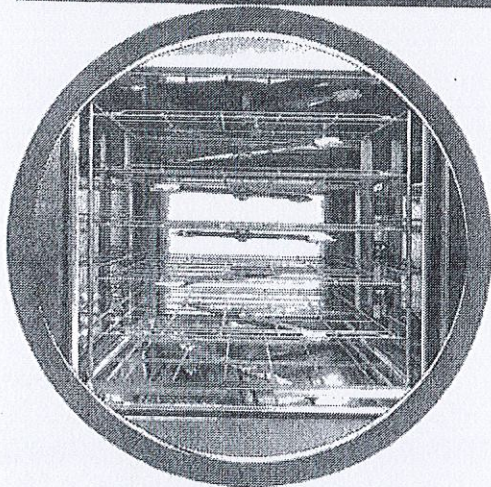


WH

WH300

WH500

WH650

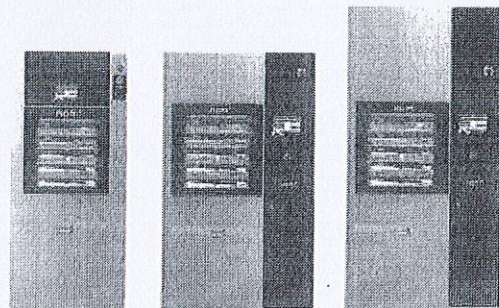

Technical specification คุณสมบัติทางเทคนิค

1	I	ใช้ล้างและทำลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไปแบบอัตโนมัติ ความจุ 300 ลิตร 500 ลิตร และ 650 ลิตร
3.1	II	มีระบบน้ำเย็น, น้ำร้อน และระบบอบแห้งในตัวแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
3.3	III	มีระบบทำน้ำร้อนภายในตัวเครื่อง ใช้ในขั้นตอนการล้าง
3.2	IV	ตัวเครื่องทำจากวัสดุ สแตนเลสสตีล แบบตู้ตั้งพื้น ความจุห้องล้าง 300 ลิตร 500 ลิตร และ 650 ลิตร ตามรุ่น
3.4	V	ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor แบบอัตโนมัติ รายงานผลผ่านระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) Software สามารถรายงานผลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ โดยรายงาน ประเภทข้อโปรแกรมที่เลือก โปรแกรมการทำงานแต่ละช่วง อุณหภูมิห้องล้าง เวลาการทำงาน และความผิดปกติของการทำงานของเครื่อง โดยเครื่องจะหยุดการทำงานเมื่อเกิดความผิดพลาด มีเสียงเตือน และแสดง Fault code บนหน้าจอ
3.5	VI	ระบบไฟฟ้า Voltage / Frequency: 380/400 V. 3 phases, 50 Hz
4.10/4.1	VII	ภายในห้องล้างทำด้วยสแตนเลสสตีล เกรด AISI 316L ส่วนประกอบของฝาปิดตัวเครื่องด้านนอก ทำจากกระจกใสและสแตนเลสสตีล และมีหลอดไฟส่องสว่าง สามารถเปลี่ยนสีตามขั้นตอนการล้างได้
4.2	VIII	ห้องล้างมีใบพัดสำหรับฉีดล้างแบบหมุน เพื่อให้การล้างทั่วถึง โดยติดตั้งอยู่ส่วนบนและระหว่างชั้นบรรจุตะกร้าล้าง
4.11/4.3	IX	มีฝาปิด 2 ประตู แบบเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวตั้ง โดยระบบใช้ถังฝาประตู ผ่านมอเตอร์ โดยที่ฝาปิดเป็นกระจกใส มองเห็นด้านใน และทนความร้อน
4.4	X	มีโปรแกรมการล้างและทำลายเชื้อไม่น้อยกว่า 30 โปรแกรม โดยสามารถล้างด้วยน้ำเย็นและน้ำร้อน
4.5	XI	มีปั๊มน้ำหมุนเวียน (Circular pump) 1 ชุด
4.6	XII	มีปั๊มดูดน้ำยาเคมีภายในตัวเครื่อง 2 ชุด และมีถังบรรจุน้ำยาจำนวน 2 ถัง ติดตั้งในตัวเครื่อง
4.7	XIII	มีระบบตรวจสอบอุณหภูมิ ให้เป็นไปตามกำหนด ป้องกันความผิดพลาดของการทำงาน
4.8	XIV	ระบบจะปิดล็อคขณะทำงาน และหากปิดไม่สนิท ระบบจะไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
4.9	XV	อากาศที่เข้ามาในห้องล้าง ในกระบวนการเป่าแห้ง ต้องผ่านระบบ Plasma Ozone เพื่อการฆ่าเชื้ออากาศ

***โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต

nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

กิตติ์

ประเสริฐ

nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

Manual transfer trolley, level loading height: 850 mm

- Two lockable antistatic castors
- Safety linking system to hook the washer (or loading/unloading system) for perfect cart loading
- Liquid collector




Dimensions mm/inches

WxDxH mm: 745x975x1050

WxDxH inches: 29.33x38.39x41.34

Materials: S.s. AISI 304, plastic components

(b.1)

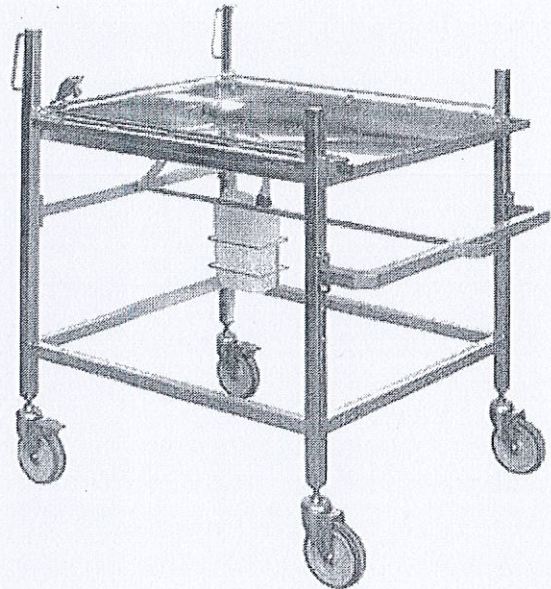

1. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
 2. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
 3. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
 4. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

สำนักงานผู้ช่วย

กิตติกร ประเสริฐสุข

กิตติกร ประเสริฐสุข

Five level instruments wash cart provided with 4 washing arms.
 All intermediate levels and washing arms are removable.

Capacity/Connections

- Up to 15 DIN 1/1 net baskets
- Up to 10 SPRI I net baskets


Dimensions mm/inches

- A = 80 / 3.15
- B = 80 / 3.15
- C = 80 / 3.15
- D = 80 / 3.15
- E = 85 / 3.35
- F = 220 / 8.66
- G = 360 / 14.17
- H = 500 / 19.68
- I = 638 / 25.20








WxDxH mm: 645 x 815 x 660

WxDxH inches: 25.39 x 32.08 x 25.98

Materials: S.s. AISI 304, plastic components

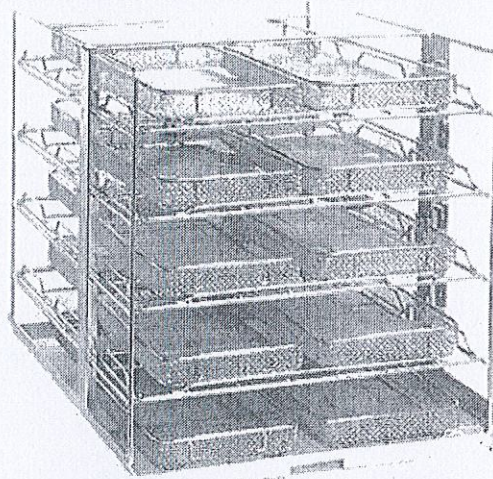

6.2



nam^o

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited (Head Office)
999/3-5 Moo 9 Petchaburi-Road Rd., Nonthaburi, Bangkok 11000, Thailand
Tel. +66 2461 7287-90 Fax +66 2461 7291
TAX ID : 0107545000654 www.namwiwat.com

DIN 1/1 mesh tray



Dimensions mm/in

- 58 / 2.28 height with accessory cover

Specifications

WxDxH mm: 480 x 250 x 50

WxDxH inches: 18.90 x 9.84 x 1.97

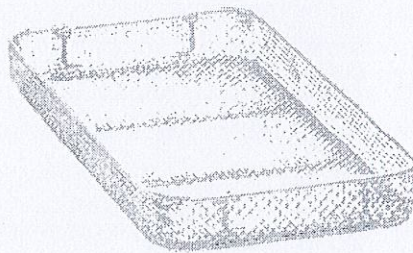

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมการแพทย์

นายแพทย์ ปรเมศวร์ งามพิสิษฐ์

nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

Product data sheet

6.4

deconex® PROZYME ALKA

Mildly alkaline/enzymatic instrument cleaner

For instrument treatment in washer-disinfectors



Ingredients

Surfactant substances
Enzymes (proteases)
Complexing agents
Solubilisers
Sequestering agents
Preservatives

Material compatibility

deconex® PROZYME ALKA is compatible with a wide range of materials.

Suitable for:

Stainless steel, aluminium, anodised aluminium, titanium, copper, brass, zinc, tin, chrome-plated materials, plastics, elastomers including polyurethane, silicone, teflon, rubber and latex, glass and ceramic materials. There is no known material incompatibility.

Appropriate compatibility tests should be performed for all materials not listed, or contact Borer Chemie AG if necessary.

Concentrate:

For compatibility with transport and peristaltic hoses, please request the separate information sheet.

CE marking

deconex® PROZYME ALKA meets the requirements for medical devices pursuant to the Medical Devices Directive 93/42/EEC.

Handwritten signature and date: 2008/07/07

deconex® PROZYME ALKA

Physicochemical data

pH	1 % solution in deionised (DI) water	approx. 10.1
Density	Concentrate	1.09 g/mL
Appearance	Concentrate	clear, yellowish

Packaging

Containers, seals and labels are made from recyclable poly ethylene.

Additional information

Please read the instructions for use and the relevant safety data sheet before using this product.

Benefit from our know-how! Please contact us for practical information on your specific application.

Container sizes

Type of container	Container content
5 l canister	5 kg
10 l canister	10 kg
25 l canister	25 kg
220 l barrel	220 kg

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Manufacturer:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

All information provided is based on our comprehensive knowledge and does not constitute a legally binding assurance of specific product properties.

บริษัท บอริเคมี จำกัด

 NAMWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท บอริเคมี จำกัด


 borer
 advanced cleaning solutions
 PUBLIC COMPANY LIMITED

nam^o

Namwatt Medical Corporation Public Company Limited (Head Office)
 9/999/3-5 Moo 9 Procharitthi-Kueang Rd., Nakhonbangkokstad.
 Phrasomut Chedl, Samutprakom 10290 Thailand
 T. +66 2461 7297-50 F. +66 2461 7291
 TAX ID : 0107565000654 www.namwatt.com

0.5

เครื่องกรองน้ำ พร้อมระบบน้ำ RO

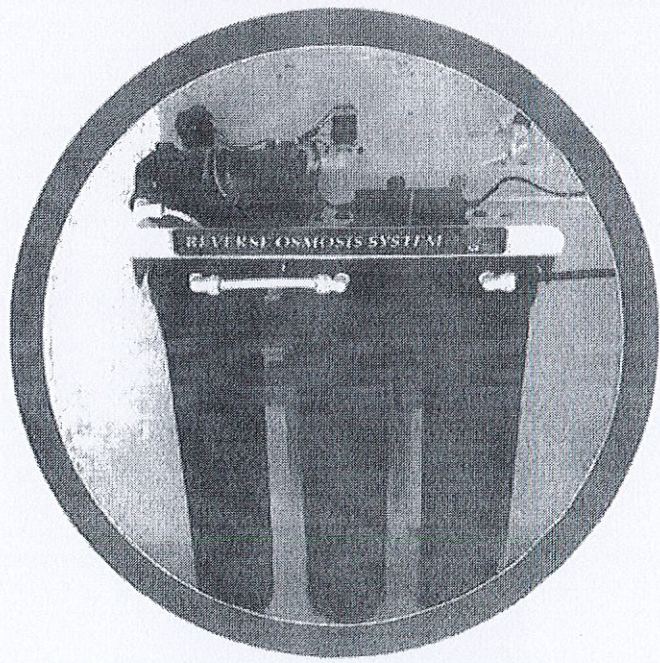

1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*

ดำเนินการด้วย

กิตติกร ปราชญ์วิเศษ

กิตติกร ปราชญ์วิเศษ

nam^o
 NAMWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

nam^o
 NAMWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

nam^o

Namwat Medical Corporation Public Company Limited (Head Office)
 999/35 Moo 9 Pichairatthi-Kusong Rd., Nakhonbangpakok.
 Prachinburi Chedi, Samutprakarn 10290 Thailand
 T +66 2461 7287-90 F +66 2461 7291
 TAX ID : 0107565000554 www.namwat.com

6.6

DESIGN

UNIBODY

STAND

304

ข้อมูลราคาเครื่อง DMB รุ่น AMCB

ประเภท เครื่อง	ขนาด	ราคา	ส่วนลด	รวม	ภาษี	รวม
AMCB 500	500					
AMCB 1000	1000					
AMCB 1500	1500					
AMCB 2000	2000					
AMCB 3000	3000					

ข้อมูลราคาเครื่อง DMB รุ่น AMCB

ประเภท เครื่อง	ขนาด	ราคา	ส่วนลด	รวม	ภาษี	รวม
AMCB 1500	1500					
AMCB 2000	2000					

✓
 2.
 3.
 4.

สำนักงานลูกค้า

ติดต่อ ประสงค์

ติดต่อ ประสงค์
nam^o
 WAT MEDICAL CORPORATION
 COMPANY LIMITED

nam^o
 NAMWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



Certificate of Approval

This is to certify that

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited

Address of premises : 999/3-5 Moo 9, Prachauthit-Khusang Road,
Naiklong Bangplakod, Prasamu Chedi District,
Samutprakarn 10290, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
TIS 9001-2559 (ISO 9001:2015)

for the scope :

1. Design, manufacture, installation, sale and service of large steam sterilizers, ethylene oxide sterilizers, washer disinfectors, ultrasonic washer, low temperature steam and formaldehyde sterilizers, hydrogen peroxide sterilizers and medical device dryer
2. Manufacture and sale of formaldehyde solutions and hydrogen peroxide solutions
3. Distribution of cleaning concentrates, disinfectants and accessories of medical devices
4. Distribution of chemical and biological indicators for sterilization processes of steam, ethylene oxide, formaldehyde, hydrogen peroxide, washer disinfectors, ultrasonic washer and dry heat
5. Sterilization of medical equipment service
6. Disinfection of infectious medical waste service

by
Management System Certification Institute (Thailand)
Foundation for Industrial Development

Date of Issue 4th November 2022

Valid Until 11th May 2025

First Issued Date 24th May 2019

Jongrak Rojpalasatean

(Mr. Jongrak Rojpalasatean)

President

Management System Certification Institute (Thailand)



MASCI



TIS 9001-2559

nam

NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED



ISO 9001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Certificate of Approval

This is to certify that

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited

Address of premises : 999/3-5 Moo 9, Prachauthit-Khusang Road,
Naiklong Bangplakod, Prasamut Chedi District,
Samutprakarn 10290, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
TIS 9001-2559 (ISO 9001:2015)

for the scope :

1. Design, manufacture, installation, sale and service of large steam sterilizers, ethylene oxide sterilizers, washer disinfectors, ultrasonic washer, low temperature steam and formaldehyde sterilizers, hydrogen peroxide sterilizers and medical device dryer
2. Manufacture and sale of formaldehyde solutions and hydrogen peroxide solutions
3. Distribution of cleaning concentrates, disinfectants and accessories of medical devices
4. Distribution of chemical and biological indicators for sterilization processes of steam, ethylene oxide, formaldehyde, hydrogen peroxide, washer disinfectors, ultrasonic washer and dry heat
5. Sterilization of medical equipment service
6. Disinfection of infectious medical waste service

by
Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for Industrial Development

Date of Issue 4th November 2022

Valid Until 11th May 2025

First Issued Date 24th May 2019

Jongrak Rojpalasatean

(Mr. Jongrak Rojpalasatean)

President

Management System Certification Institute (Thailand)



MASCI



บริษัท นามวิวัฒน์ จำกัด
nam
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

nam
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

72



ISO 13485
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES

Certificate of Approval

This is to certify that

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited

Address of premises : 999/3-5 Moo 9, Prachauthit-Khusang Road,
Naiklong Bangplakod, Prasamut Chedi District,
Samutprakarn 10290, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
ISO 13485:2016 Quality Management System for Medical Devices

for the scope :

1. Design, manufacture, installation, sale and service of large steam sterilizers, ethylene oxide sterilizers, washer disinfectors, ultrasonic washer, low temperature steam and formaldehyde sterilizers, hydrogen peroxide sterilizers and medical device dryer
2. Manufacture and sale of formaldehyde solutions and hydrogen peroxide solutions
3. Distribution of cleaning concentrates, disinfectants and accessories of medical devices
4. Distribution of chemical and biological indicators for sterilization processes of steam, ethylene oxide, formaldehyde, hydrogen peroxide, washer disinfectors, ultrasonic washer and dry heat
5. Sterilization of medical equipment service
6. Disinfection of infectious medical waste service

by
Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for Industrial Development

Date of Issue 4th November 2022

Valid Until 11th May 2025

First Issued Date 28th June 2019th

Jongrak Rojpalasatean

(Mr. Jongrak Rojpalasatean)

President

Management System Certification Institute (Thailand)



MASCI

นามวิวัฒน์
nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

นามวิวัฒน์
nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

42



Thai International Certified Assessment Co., Ltd.
Management System Certificate

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited

999/3-5 Moo 9, Prachauthit-Ku Sang Road, Nai Khlong Bang Pla Kot,
Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290 Thailand

Thai International Certified Assessment Co., Ltd. hereby certify that the aforementioned organization
has implemented and maintained the following standard :

ISO 14001:2015

This certificate remains the property of Thai International Certified Assessment Co., Ltd. It is contingent of
meeting agreed contractual requirements. Validity is maintained through a process continual assessments
and reassessment. To be read in conjunction with the scope of registration shown on the attached appendix.

Certificate Number : TE-156
Date of Original Registration : 18 March 2021
Date of Current : 03 November 2022
Date of Registration Expires : 18 March 2024

1.
2.
3.
4.
5.

(Page 1 of 2)

Signed on behalf of TICA



Scan QR Code to
verify real certification



Thai International Certified
Assessment Co., Ltd.

NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
Designed by: Mr Thee Thee

4.9



Two Park Avenue

tel 1.212.591.7575

New York, NY

fax 1.212.591.8599

10016-5990 U.S.A.

www.asme.org

February 3, 2023

Wisit Chaiturdkiat
Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited
999/3-5 Moo 9 Prachauthit- Kusang Rd.
Naiklongbangplakod, Phrasamut Chedi, Samutprakan, 10290
Thailand

Subject: Revised ASME Certificates of Authorization 'S' #57050 & 'U' #57051

Expiring: March 28, 2025

Revision: Name change from Namwiwat Engineering (1992) Co., Ltd.

Dear Wisit Chaiturdkiat:

Enclosed are the subject revised Certificates.

Please discard the previously held Certificates since the enclosed are the official Certificates of record.

Sincerely,

Janet Hill
Program Administrator
ASME Conformity Assessment Department
(212) 591-8581
hillj@asme.org

JH/-109380

cc: File

Encl.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '2' and some illegible text.

Handwritten Thai text: "เอกสารแนบ"

Handwritten Thai text: "เรื่อง บริษัท นามวิวัฒน์"

Handwritten Thai text: "เรื่อง บริษัท นามวิวัฒน์"

nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED



CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

The named company is authorized by The American Society of Mechanical Engineers (ASME) for the scope of activity shown below in accordance with the applicable rules of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. The use of the ASME Single Certification Mark and the authority granted by this Certificate of Authorization are subject to the provisions of the agreement set forth in the application. Any construction stamped with the ASME Single Certification Mark shall have been built strictly in accordance with the provisions of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

COMPANY:

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited
 999/3-5 Moo 9 Prachauthit- Kusang Rd.
 Naiklongbangplakod, Phrasamut Chedi, Samutprakan 10290
 Thailand

SCOPE:

Manufacture of pressure vessels at the above location and field sites controlled by the above location (This authorization does not cover impregnated graphite)


AUTHORIZED: **March 28, 2022**


EXPIRES: **March 28, 2025**

CERTIFICATE NUMBER: **57051**

Board Chair, Conformity Assessment

Managing Director, Standards & Engineering Services





CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

The named company is authorized by The American Society of Mechanical Engineers (ASME) for the scope of activity shown below in accordance with the applicable rules of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. The use of the ASME Single Certification Mark and the authority granted by this Certificate of Authorization are subject to the provisions of the agreement set forth in the application. Any construction stamped with the ASME Single Certification Mark shall have been built strictly in accordance with the provisions of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

COMPANY:

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited
 999/3-5 Moo 9 Prachauthit- Kusang Rd.
 Naiklongbangplakod, Phrasamut Chedi, Samutprakan 10290
 Thailand

SCOPE:

Manufacture and assembly of power boilers at the above location and field sites controlled by the above location



AUTHORIZED: March 28, 2022
EXPIRES: March 28, 2025
CERTIFICATE NUMBER: 57050


Ronald B. Caplan

Board Chair, Conformity Assessment

LM Zusinberg

Managing Director, Standards & Engineering Services

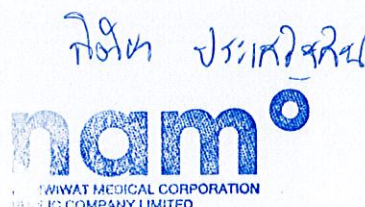



EU - type Examination Certificate

This is to certify that the product listed below conforms to the requirements of the
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
Annex III Module B (production)

Certificate Number	HPiVS-IP1019-003-I-01-02		
Date of Issue	08-Nov-2022	Date of Expiry	06-Jul-2030
Manufacturer	Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited 999/3 MOO.9 PRACHA UTHIT-WAT-KHU SANG ROAD, NAI KLONG BANG PLA KOT, PHRA SAMUT CHEDI, SAMUTPRAKAN 10290 THAILAND.		
Description of Pressure Equipment	Steam sterilizers A991P, A995P and A999P		
Drawing No	TSM-A991P, A995P, A999P rev. 2		
Representative Specimen Serial No	A991P20-1 (prototype), A995P20-1 (prototype), A999P20-1 (prototype)		
Design Pressure (bar)	3.0 bar / F.V. bar		
Design Temperature (°C)	0-144 °C		
Standards Used	ASME VIII Div 2 2019 Ed.		
Report Reference	HPiVS-IP1019-003-1 issued to THAI STEEL METAL CO., LTD.		

This Certificate is valid in any European Economic Area Member State.

This Certificate has been issued by HPi Verification Services (Ireland) Ltd. which is a body notified to the European Commission according to the provisions of the Pressure Equipment Directive (Notified Body number 2810).

This Certificate is issued following the assessment of a representative sample of the Pressure Equipment detailed above in accordance with the provisions of the above regulations. The equipment must be subject to an appropriate conformity assessment module during manufacture prior to the CE Mark being affixed.

Check this certificate is genuine



Quality Director

Technical Director

An INAB accredited Certification Body 6022

nam
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED



EU Notified Body No. 2810
Company registered in Ireland #577786

© HPi Verification Services (Ireland) Ltd. 2022

Tel +353 (0)1 8017008

Email enquiries@hpivs.ie
www.hpivs.ie

nam
HPi Verification Services (Ireland) Ltd.
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

Clonross
Dunshaughlin, Co.Meath
A85 XN59, Ireland

74

SO 2565/ 633

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เรียน ประธานคณะกรรมการปี ดของสอบราคา/ประกวดราคา

เรื่อง หนังสือรับรอง (ใบผ่านงาน)

ตามที่ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมยื่นซองสอบราคา/ประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดต่างๆ, เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100%, เครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ, เครื่องเป่าแห้งอุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องอัลตราโซนิก, เครื่องล้างอุปกรณ์ท่อสายยางทางการแพทย์ขนาดต่างๆ และผู้เสนอราคาต้องมี หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องและต้องแสดงหลักฐานว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ โดยมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง นั้น

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์ ได้ผ่านการ ฝึกอบรมการปฏิบัติงานการตรวจซ่อมบำรุงรักษาและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ | 2.นายฉลอง เพ็ชรชู | 3.นายคมสันต์ กันทะโสม |
| 4.นายแสวง บุญธง | 5.นายทัศนสันต์ ทองจันทร์ | 6.นายจิรพงษ์ พักสิทธิ์ |
| 7.นายสุรศักดิ์ หาญจริยีนอง | 8.นายวิทวัส วงศ์จักร | 9.นายมนชัย ว่องเยี่ยมพันธุ์ |
| 10.นายกิจเดช นิยมทรัพย์ | 11.นายอภิรักษ์ ไชยวงศ์ | 12.นายไพศาล ถาวรบรรจบ |
| 13.นายชัยมงคล กุลมิตร | 14.นายสุริยา ทองคำ | 15.นายเกียรติศักดิ์ นาข้าว |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

nam^o
NAMWATT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

nam^o
NAMWATT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๔๔/๓-๕ หมู่ที่ ๔ ถนน ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ตำบล ในคลองบางปลา กต อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๔๔๖๓๙๖ โดย นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบ จ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ หัวจ่าย	-	-	๑ เครื่อง	๘๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
๒	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลิตร	-	-	๑ เครื่อง	๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
๓	เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติ พร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร	-	-	๑ เครื่อง	๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
๔	เครื่องฆ่าเชื้อและกำจัดฝุ่น ละอองในอากาศชนิดไร้แผ่น กรองขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	-	-	๒ เครื่อง	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๕,๐๕๗,๐๐๐.๐๐	

(ห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้
เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด
ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิตติยา ประเสริฐสิน,
(นางสาวกิตติยา ประเสริฐสิน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ใบเสนอราคาเลขที่ 6602160027965

รหัสอ้างอิง OTP tSum

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๖๕๐๐๐๖๕๔

nam^o
NAMWIAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

.....
.....
.....
.....
.....
.....



UOB

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited 690 Sukhumvit Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand
ทะเบียนการค้า/ Co. Reg. No. 0107535000176

เมื่อหมดอายุบังคับแล้วโปรดส่งคืนธนาคาร

No. 606504



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)

(กรณีปกติ)

เลขที่ 06851000003 OCM PG219505

วันที่ 5 เมษายน 2566

ข้าพเจ้า ธนากรบุญโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 356 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพัฒนจิตา งามวิทยานนท์ และ นายวุฒิพร ยังยืน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนากร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท นวัตกรรม เมคคอลล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน 113,500.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะรับประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จำนวน ไม่เกิน 113,500.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิด ความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญา ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อ ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้หนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เกิดอาการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลา
 คำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารยโอบี จำกัด (มหาชน)

Ham.

2297

(นางสาวพัฒนจิตา งามวิทยานนท์

นายวุฒิพร ยิ่งยืน

6. June 1946 03950

พยาน

(นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ พรหมปัญญา)

638cc

.....พยาน

(นายภาณุพงศ์ เลิศไธสง)

หากท่านต้องการยื่นข้อคัดค้านการออกหนังสือคำประกัน ขอให้ยื่นขึ้นได้ที่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการการค้าระหว่างประเทศ ชั้น 15 อาคารบี
เลขที่ 559 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ਜੇਠੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ

namo
NAMVIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED