

สัญญาซื้อขาย ตู้เย็นเก็บศพ ชนิดเก็บได้ ๒ ศพ

สัญญาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เมดิคูล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๐๒/๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวชนิษฐา ทาแพงน้อย ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ นบ.๐๐๔๓๙๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้เย็นเก็บศพ ชนิดเก็บได้ ๒ ศพ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๖๒๖.๑๙ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๓ (สาม)	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

บริษัท เมดิคูล จำกัด

MediCool Co.,Ltd/ข้อ ๔ การส่งมอบ...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวชนิษฐา ทาแพงน้อย)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เมดิคูล จำกัด

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

บริษัท เมดิคูล จำกัด
MediCool Co., Ltd. / ข้อ ๘ หลักประกัน...

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นางสาวชนิษฐา ทาแพงน้อย)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เมดิคูล จำกัด

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของฝ่ายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุทธไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

บริษัท เมดิคูล จำกัด

MediCool Co., Ltd. ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ...

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นางสาวนิตฐา ทาแพงน้อย)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เมดิคูล จำกัด

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่จะต้องใช้เรือไทยเป็นพาหนะในการขนส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

บริษัท เมดิคูล จำกัด

MediCool Co., Ltd.

/ในการส่งมอบ...


(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รัชการาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นางสาวนิษฐา ทาแพงน้อย)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เมดิคูล จำกัด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรจุมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรจุจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรจุของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรจุของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....*กมล ใจดี*.....ผู้ซื้อ
(นายสมศักดิ์ ใจดี ใจดี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....*นางสาวชนิษฐา ทาแพงน้อย*.....ผู้ขาย
(นางสาวชนิษฐา ทาแพงน้อย)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท เมดิคูล จำกัด

(ลงชื่อ).....*นางสาวสายชล ธัญธริษตรี*.....พยาน
(นางสาวสายชล ธัญธริษตรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....*นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม*.....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เย็นเก็บศพ ชนิดเก็บได้ ๒ ศพ

๑. ความต้องการ

ตู้เย็นเก็บศพ ชนิดเก็บได้ ๒ ศพ ขนาด ๒ ช่อง แบบ ๒ ชั้น ชั้นละ ๑ ช่อง ชนิดนำศพเข้าด้านหน้า แต่ละช่องมีประตูเปิด - ปิด และมีระบบกุญแจล็อกแยกแต่ละช่อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดจากการใช้งานเป็นเวลานาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ใช้สำหรับเก็บรักษาศพหรืออวัยวะของมนุษย์ไม่ให้เน่าเปื่อย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาศพหรืออวัยวะของมนุษย์ไม่ให้เน่าเปื่อย
- ๓.๒ เป็นตู้เย็นขนาด ๒ ช่อง แบ่งเป็น ๒ ชั้น ชั้นละ ๑ ช่อง ชนิดนำศพเข้าด้านหน้า แต่ละช่องมีประตูสามารถเปิด - ปิด และมีระบบกุญแจล็อกแยกแต่ละช่อง พร้อมล้อสามารถเคลื่อนที่และล็อกให้อยู่กับที่ได้
- ๓.๓ มีระบบทำความเย็น สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๒ ถึง ๑๐ องศาเซลเซียส โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็นที่มีมาตรฐาน และมีเอกสารรับรองความถูกต้องของอุณหภูมิตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕
- ๓.๔ มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขแบบดิจิทัล พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอกช่องที่กำหนดไว้
- ๓.๕ ผนังตู้ภายในและภายนอกผลิตจาก Stainless steel ชนิด ๓๐๔ คุณภาพสูง ป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี ทนทานต่อการใช้งาน
- ๓.๖ ประตูของตัวตู้ทำจาก Stainless steel ชนิด ๓๐๔ ทั้งด้านในและด้านนอก บานประตูเปิด - ปิดเป็นแบบสวิง ช่วยผ่อนแรงเมื่อใช้งานได้ มีมือจับแบบดึงพร้อมกุญแจล็อก
- ๓.๗ มียางตามขอบของบานประตู สำหรับป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตู้เย็น
- ๓.๘ ขนาดโครงสร้างตู้ภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง) ๙๖ x ๒๕๐ x ๑๙๕ เซนติเมตร
- ๓.๙ ภายในตู้เย็นมีรางเลื่อน Telescoping Tray System พร้อมถาดสแตนเลสสำหรับใส่ศพ ขนาด (กว้าง x ยาว) ๖๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ถาด
- ๓.๑๐ ระบบล็อกชัตติลูกปืนหรือล้อเลื่อนที่มีความมั่นคงแข็งแรง และเบาแรงขณะเลื่อนเข้าออกเมื่อเคลื่อนย้ายศพและมีตัวล็อกเมื่อถึงสุดระยะ เพื่อป้องกันถาดหล่นจากรางเลื่อน
- ๓.๑๑ พื้นตู้ชั้นล่าง มีความลาดชัน และมีท่อระบายน้ำทิ้งออกจากตัวตู้ไม่ให้มีน้ำคั่งค้างอยู่
- ๓.๑๒ มีระบบละลายน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ
- ๓.๑๓ มีหลอดไฟส่องสว่างภายในตู้ แบบกันน้ำ จำนวน ๒ หลอด พร้อมสวิตช์ เปิด - ปิด


๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ ใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ๕๐ - ๖๐ เฮิร์ต พร้อมระบบกราวด์

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายพนพล ทับเปรม)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



MediCool Co., Ltd.

กนกพร กนกพร

- ๔.๒ คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น แบบ Hermatic Compressor ใช้น้ำยาทำความเย็นชนิด R-๑๓๔a หรือ R-๒๙๐
- ๔.๓ ฉนวนป้องกันความร้อนรอบด้านทั้งหมดของตู้ เป็นชนิด Polyurethane ที่มีความหนาแน่นสูง โดยมีความหนาของฉนวน ๑๐ ซม.
- ๔.๔ ชุดคอยล์เย็น (Condensing Unit) ทำจากวัสดุอลูมิเนียม ป้องกันสนิม
- ๔.๕ มีพัดลมระบายความร้อน
- ๔.๖ มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ตก - เกิน (Safe Guard) ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบทำความเย็นได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการหลังการขาย ที่มีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖
- ๕.๒ ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (User Manual) อย่างละ ๑ ชุด
- ๕.๔ มีคู่มือการใช้งานและแก้ไขอย่างง่ายสำหรับแวนดิดที่ตัวเครื่อง จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๕ รับประกันคุณภาพเครื่องและอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับประกันคอมเพรสเซอร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายยินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งค่าอะไหล่และค่าบริการอื่นด้วย
- ๕.๖ ผู้ขายต้องเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทุก ๆ ๔ เดือน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
- ๕.๗ กรณีที่เครื่องมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วันหลังวันส่งมอบ ผู้ขายยินดีจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตามข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะเดิมหรือดีกว่า
- ๕.๘ กรณีเครื่องมีปัญหา เมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งให้เข้าทำการแก้ไข ทางผู้ขายจะต้องจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๒ วัน หากพบว่าเครื่องชำรุดต้องทำการส่งซ่อมเกิน ๗ วัน ทางผู้ขายยินดีนำเครื่องสำรองมาให้ใช้ทดแทนจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จตามข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะเดิม หรือดีกว่า
- ๕.๙ หากมีการซ่อมหรือแก้ไขแล้วเกิน ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๓ เดือนนับจากวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเครื่องใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตามข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะเดิมหรือดีกว่า

ลงชื่อ.....

(นายพนพล ทับเปรม)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



๑๖/๑๖/๒๕๖๒

๕.๑๐ ผู้ขายต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วน และเพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบ SPECIFICATION

๕.๑๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยสาธิตหรือใช้งานมาก่อน

๕.๑๒ ผู้ขายจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่องให้กับ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องก่อนส่งมอบ

๖. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

เกณฑ์ราคา


๘. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ

จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายพนพล ทับเปรม)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



บริษัท เมดิคูล จำกัด
MediCool Co.,Ltd.

อินทพร งามเมือง

ใบเสนอราคา
QUOTATION

รหัสลูกค้า C00429

Customer's Code

เงื่อนไขการชำระเงิน 30 วัน

Term of Payment

เลขที่ QT660313-003

No.

วันที่

Date

พนักงานขาย ขนิษฐา 098-827-0515

เรื่อง ขอเสนอราคาสินค้า

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางพลี

บริษัทฯ มีความยินดี ขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับ Item	รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียดสินค้า Descriptions	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	MDC-MOU-02F	ตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง แบบเปิดหน้า หมายเหตุ : 1.รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี	1	300,000.00	300,000.00
			ส่วนลดพิเศษ		0.00
(สามแสนบาทถ้วน).			รวม / Total		280,373.83
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7%		19,626.17
			รวมทั้งสิ้น / Grand Total		300,000.00

ผลิตภัณฑ์ MediCool Thailand

กำหนดขึ้นราคา / Price 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

กำหนดส่งสินค้า / 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสินค้าจากท่าน และขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กรุณาเซ็นเอกสารส่งกลับมายังบริษัทฯ เมื่อยืนยันการสั่งซื้อ

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ

วันที่



บริษัท เมดิคูล จำกัด

MediCool Co.,Ltd.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

.....

(ธนกฤต รุ่งภัทรวัฒน์)



MEDICOOL CO.,LTD.

RECOMMENDED FOR CERTIFICATION ISO9001:2015 AND ISO13485:2016



บริษัท เมดิคูล จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 202/10 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สาขาที่ 00001 : 288/72 ซอยวิภาวดีรังสิต 70 (พชรภา) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel: 02-005-0900-1 Fax: 02-101-6440

ตู้เย็นเก็บศพ ขนาด 2 ช่อง ชนิดนำศพเข้าด้านหน้า

รายละเอียดคุณลักษณะตู้เย็นเก็บศพ

1. เป็นตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาศพหรืออวัยวะของมนุษย์ไม่ให้เน่าเปื่อย
2. เป็นตู้เย็นขนาด 2 ช่อง แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 1 ช่อง ชนิดนำศพเข้าด้านหน้า แต่ละช่องมีประตูสามารถเปิด-ปิด และมีระบบกุญแจล็อกแยกแต่ละช่อง
3. มีระบบทำความเย็นสามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็นที่มีมาตรฐานสูงและมีเอกสารรับรองความถูกต้องของอุณหภูมิตามมาตรฐาน ISO 17025
4. มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอกช่องที่กำหนดไว้
5. ผนังตู้ภายในและภายนอกผลิตจาก Stainless steel คุณภาพสูง ป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี
6. บานประตู เปิด-ปิด แบบสวิง ช่วยผ่อนแรงเมื่อใช้งานได้
7. ขนาดโครงสร้างตู้ภายนอก (กxลxส) 96x250x195 ซม.
8. ภายในตู้เย็นมีรางเลื่อน Telescoping Tray System พร้อมถาดสแตนเลสสำหรับใส่ศพ ขนาด (กxย) 60x200 ซม. จำนวน 2 ถาด
9. ระบบลิ้นชักติดลูกปืนหรือล้อเลื่อนที่มีความมั่นคงแข็งแรง และเบาแรงขณะเลื่อนเข้าออกเมื่อเคลื่อนย้ายศพและมีตัวล็อกเมื่อถึงสุดระยะเพื่อป้องกันถาดหล่นจากรางเลื่อน
10. ฉนวนป้องกันความร้อนรอบด้านทั้งหมดของตู้ เป็นชนิด Polyurethane ที่มีความหนาแน่นสูง โดยมีความหนาของฉนวน 10 ซม.
11. มียางตามขอบของบานประตู สำหรับป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตู้เย็น
12. พื้นตู้ชั้นล่าง มีความลาดชัน และมีท่อระบายน้ำทิ้งออกจากตัวตู้ไม่ให้น้ำคั่งค้างอยู่
13. มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
14. มีหลอดไฟส่องสว่างภายในตู้ แบบกันน้ำ จำนวน 2 หลอด พร้อมสวิตช์ เปิด/ปิด
15. คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น แบบ Hermetic Compressor ใช้น้ำยาทำความเย็นชนิด R-134a หรือ R-290
16. ชุดคอยล์เย็น (Condensing Unit) ทำจากวัสดุอลูมิเนียม ป้องกันสนิม
17. มีพัดลมระบายความร้อน
18. มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ตก-เกิน (Safe Guard) ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบทำความเย็นได้
19. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50-60 เฮิร์ต พร้อมระบบกราวด์
20. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการหลังการขาย ที่มีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 13485:2016
21. สิ้นค้ารับประกัน 1 ปี



บริษัท เมดิคูล จำกัด
MediCool Co.,Ltd.

ธนภฤต รุ่งภัทรวัฒน์



MEDICOOL CO.,LTD.

RECOMMENDED FOR CERTIFICATION ISO9001:2015 AND ISO13485:2016




บริษัท เมดิคูล จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 202/10 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สาขาที่ 00001 : 288/72 ซอยวิภาวดีรังสิต 70 (เพ็ชรภาฯ) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel: 02-005-0900-1 Fax: 02-101-6440


ตู้เย็นเก็บศพ (ชนิดน้ำศพเข้าด้านหน้า)

1. ตู้เย็นเก็บศพ (Mortuary Refrigerator) เปิดด้านหน้า สำหรับเก็บรักษาสภาพศพของผู้เสียชีวิตให้สมบูรณ์
2. ตู้เย็นเก็บศพมีลักษณะ 2 ชั้น สามารถเก็บรักษาศพผู้เสียชีวิตได้ 2 ศพ
3. ใช้กระแสไฟฟ้า 220 Volt 1 phase 50-60 Hz
4. ขนาดโครงสร้างตู้ภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) 96 x 250 x 195 เซนติเมตร
5. กาดสแตนเลสสำหรับใส่ศพ ขนาด (กว้าง x ยาว) 60 x 200 เซนติเมตร
6. วัสดุภายนอกและภายในตู้เย็นเก็บศพผลิตจาก Stainless Steel Grade - 304 ทำให้คงทนต่อการใช้งาน
7. สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส
8. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



บริษัท เมดิคูล จำกัด
MediCool Co.,Ltd.

ธนภฤต รุ่งภัทรวัฒน์

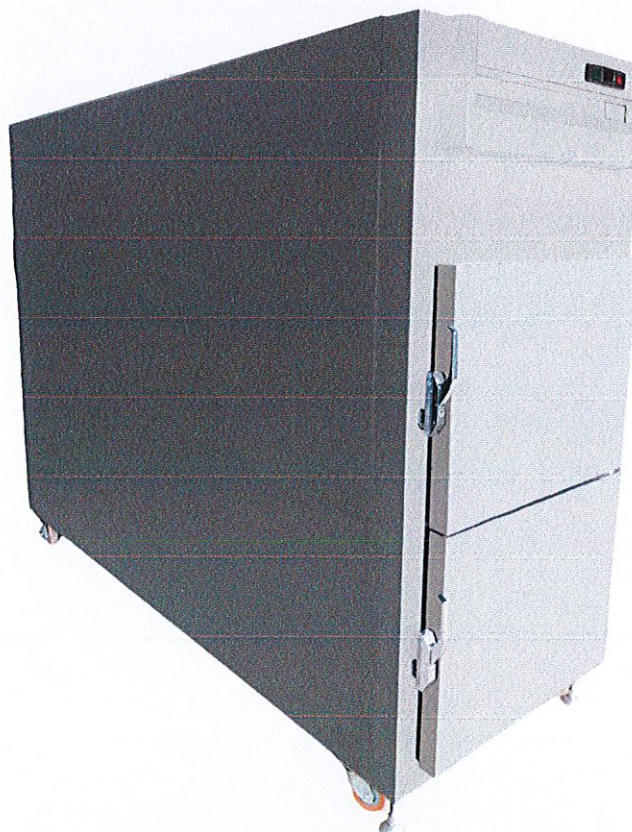

Specification

Model	MDC-MOU-02F
Exterire Dimensions (W x D x H)	96 x 250 x 195 cm.
Interire Dimensions (W x D)	60 x 200 cm.
Temperature Range	2 to 10 Degrees Celsius
Power Supply	220V, 50-60 Hz.