

**สัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ
พร้อมวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๔ เครื่อง**

สัญญาเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๑๐, ๒๑๒ ถนนจ๊กกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายภาคภูมิ ชุ่มชูจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สป.๐๑๙๔๘๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๔ เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๙,๒๓๓.๖๔ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย


ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๓ (สาม)	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

/ข้อ ๔ การส่งมอบ...

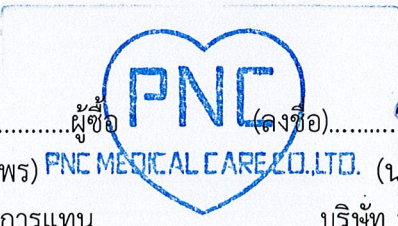

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร) PNC MEDICAL CARE CO., LTD. (นายภาคภูมิ ชุ่มชูจันทร์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

/ข้อ ๘ หลักประกัน...

(ลงชื่อ).....
(นายสมศักดิ์ ไข่มุขทรัพย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



(ลงชื่อ).....
(นายภาคภูมิ ชุ่มชูจันทร์)

บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร์ จำกัด

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุทธไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายภาคภูมิ ชุ่มชูจันทร์)

บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด

/ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ...



ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ไขทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

PNC MEDICAL CARE (P) LTD.

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....

(นายภาคภูมิ ชุ่มชูจันทร์)

บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด

ในการส่งมอบ...

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก ของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของ ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไข่มพัสสาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายภาคภูมิ ชุ่มชูจันทร์)

บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายชล ธัญธริษฐ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

๑. ความต้องการ

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรพร้อมอุปกรณ์

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ใช้วัดสัญญาณชีพจรของผู้ป่วย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่

๒.๒ ใช้วัดความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP) และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สามารถวัดและแสดงค่า Systolic, Diastolic, MAP, HR และ % SpO_2 ได้พร้อมกัน

๓.๒ จอแสดงผลคมชัด เป็นจอภาพชนิด Color TFT LCD (Touch Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ x ๖๐๐ pixels

๓.๓ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ Volts ๕๐ Hz และมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ภายในตัวเครื่องชนิด Lithium ion ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ mAh เมื่อประจุไฟฟ้าเต็มสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง

๓.๔ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีหูหิ้วด้านบนเครื่อง

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ การตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

๔.๑.๑ สามารถวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนได้ในช่วง ๐ - ๑๐๐ %

๔.๑.๒ มีค่าความแม่นยำสำหรับผู้ใหญ่ ± 2 bpm ที่ ๗๐ - ๑๐๐ % หรือดีกว่า

๔.๑.๓ สามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณของการวัด SpO_2 ได้ และแสดงค่าของชีพจรได้

๔.๑.๔ สามารถวัดค่าชีพจรได้ในช่วง ๒๐ - ๒๕๐ bpm ความคลาดเคลื่อน ± 3 bpm หรือดีกว่า

๔.๒ การตรวจวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ Non-Invasive


๔.๒.๑ ใช้ระบบการตรวจวัดแบบ Oscillometric Method

๔.๒.๒ สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก วัดได้ในช่วง

ผู้ใหญ่ ๓๐ - ๒๗๐ mmHg

เด็กโต ๓๐ - ๒๓๕ mmHg

เด็กเล็ก ๓๐ - ๑๓๕ mmHg

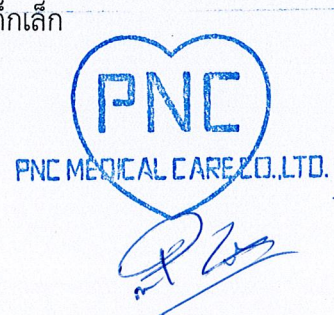

/๔.๒.๓ สามารถแสดง...

๑. นางมณีนรัตน์ ดีใจ

๒. นางสาวภัทรสุดา แพเจริญ

๓. นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ษา

.....
.....
.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

- ๔.๒.๓ สามารถแสดงค่า Systolic diastolic และ Mean ได้พร้อมกัน
- ๔.๒.๔ มีโหมดในการวัดไม่น้อยกว่า ๓ แบบ คือ Manual, Automatic และ STAT
- ๔.๒.๕ สามารถตั้งสัญญาณเตือนกรณีค่าที่วัดสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ได้
- ๔.๒.๖ ความแม่นยำในการวัด ± 3 mmHg หรือดีกว่า
- ๔.๒.๗ ตัวเครื่องมีขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เหตุการณ์

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ NIBP Air hose	๑	ชุด
๕.๒ BP cuff Adult (ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อ้วน เด็กโต)	๓	ผืน
๕.๓ Adult Finger SpO ₂ sensor	๒	เส้น
๕.๔ AC Power	๑	เส้น

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานดูแลบำรุงรักษาและการตรวจซ่อมภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- ต่อ ๑ เครื่องให้กับหน่วยงานผู้ใช้งาน
- ๖.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยสาธิตหรือใช้งานมาก่อน
- ๖.๓ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๖.๔ ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง ๒ ครั้งต่อปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
- ๖.๕ ภายในระยะเวลาประกัน หากต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน ทางโรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งค่าอะไหล่และบริการอื่น
- ๖.๖ กรณีที่มีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วันหลังส่งมอบ ผู้ขายยินดีจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตามคุณลักษณะเฉพาะเดิมหรือดีกว่า
- ๖.๗ กรณีมีปัญหาการใช้งาน เมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งให้เข้าทำการแก้ไข ทางผู้ขายจะจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๓ วัน หากพบว่าการชำรุดต้องทำการส่งซ่อมนานเกิน ๗ วัน ทางผู้ขายยินดีเครื่องสำรองมาให้ใช้ทดแทนจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ
- ๖.๘ หากมีการซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้วเกิน ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๓ เดือนนับจากวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเครื่องใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตามคุณลักษณะเฉพาะเดิมหรือดีกว่า
- ๖.๙ ผู้ขายจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องก่อนส่งมอบ

๗. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

เกณฑ์ราคา

PNC
PNC MEDICAL CARE CO., LTD.

/๙. วงเงินงบประมาณ...

๑. นางมณีนันท์ ดีใจ

๒. นางสาวภัทรสุดา แพเจริญ

๓. นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ษา

.....
.....
.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๙. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ

จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. ราคากลางที่จะซื้อ

จำนวนเงิน ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฉันทนา อึ้ง

.....ประธานกรรมการ

(นางมณีนรีรัตน์ ตีใจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....กรรมการ

(นางสาวภัทรสุดา แพเจริญ)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อติพร วงศ์ษา

.....กรรมการ

(นางสาวอติพรรัตน์ วงศ์ษา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

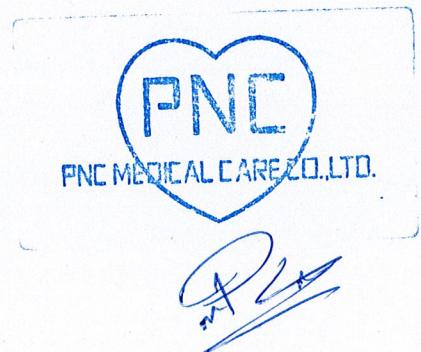

TECHNICAL SPECIFICATION:

V9

Size and Weight

Size 308mm×233mm×125mm

Weight <4kg

Power

Standard According to IEC 60601-1 and IEC 60601-1-2

Input voltage 100V-240V AC

Frequency 50Hz/60Hz

Input current 1.5A-0.7A

Fuse T 2A/250V, integrated in the power module

Display

Type Color TFT LCD

Size (diagonal) 8 inch

Resolution 800×600 pixels

Recorder (Option)

Type Thermal dot array

Paper width 48 mm

Paper length 15 m

Recording speed 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Recording waveform 1 track, 2 track

Battery

Type Rechargeable Lithium ion battery 10.8V/6.6AH

Operating time >10 hours

(1 new and fully charged battery at 25

°C temperature, connecting

SpO2 sensor & NIBP work on AUTO mode for 15 minutes interval)

Charge time 6h to 100% (Standby)

Data Storage

Patient numbers >1000

Parameter measurement event >5000 items

Alarm event >10000 items

Log event >10000 items

Interfacing & I/O devices

Keyboard & Mouse Support

Barcode Scanner Support 1D barcode (USB connector)

Wired network 1 standard RJ45 interfaces

USB socket 2 sockets

Nurse call 1 RJ11 connector for nurse call

MicroFlow CO2 (option)

Warm up time Capnogram displayed in less than 20s, at ambient

temperature <25

Measurement range 0% to 19.7% (0 mmHg to 150 mmHg)

Resolution 0.1% or 1 mmHg

Unit %, mmHg, kPa

Accuracy 0 mmHg to 40 mmHg, ±2 mmHg

41 mmHg to 70 mmHg, ±5% of reading

71 mmHg to 100 mmHg, ±8% of reading

101 mmHg to 150 mmHg, ±10% of reading

awRR range 2 rpm to 150 rpm

awRR accuracy ±1 rpm

Sample flow rate 50 ml/min ± 10 ml/min

BLT Digital SpO2

Measurement range 0% ~ 100%

Accuracy 70% ~ 100% ±2%

0% ~ 69% unspecified

PR

Measurement range 20 bpm to 250 bpm

Accuracy ±1% or ±1 bpm, whichever is the greater

Nellcor SpO2 (option)

Measurement range 0% to 100%

Accuracy 70% to 100%: ±2% (adult/pediatric)

70% to 100%: ±3% (neonate)

0% to 69% unspecified

PR

Measurement range 20 bpm to 300 bpm

Accuracy 20 bpm to 250 bpm: ±3 bpm

251 bpm to 300 bpm: unspecified

Masimo SpO2 (option)

Measurement range 0% to 100%

Accuracy 70% to 100%: ±2% (adult/pediatric, non-motion)

70% to 100%: ±3% (neonate, non-motion)

70% to 100%: ±3% (motion conditions)

0% to 69% unspecified

PR

Measurement range 25 bpm to 240 bpm

Accuracy ±3 bpm (non-motion conditions)

±5 bpm (motion conditions)

PI

Measurement range 0.05% to 20%

NIBP

Measurement way Automatic oscillometry

Measurement mode Manual, Auto, STAT

Intervals for Auto measurement: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90 min, 2/4/8h

Systolic range Adult 30 to 270 mmHg

Pediatric 30 to 235 mmHg

Neonatal 30 to 135 mmHg

Diastolic range Adult 10 to 220 mmHg

Pediatric 10 to 220 mmHg

Neonatal 10 to 100 mmHg

Mean range Adult 20 to 235 mmHg

Pediatric 20 to 225 mmHg

Neonatal 20 to 125 mmHg

Pressure accuracy Static: ±3 mmHg

Clinic: Average error ±5 mmHg

Standard deviation: ≤8 mmHg

Cuff pressure range 0 to 300 mmHg

PR range 40 bpm to 240 bpm

Software overpressure protection Adult (297±3) mmHg

Pediatric (252±3) mmHg

Neonatal (147±3) mmHg

Fast Temperature

Sensor type Thermosensitive sensor

Measurement range 30.0

°C ~ 43.0°C

Measurement part Oral, Axillary, Rectal

Measurement modes Direct mode: Monitor modes

Adjusted mode: Quick modes and Cold modes

Unit: °F

Resolution 0.1°C or 1°F

Accuracy ±0.1°C (±0.2°F)

Laboratory (Constant temperature water tank)

Measurement time Adjusted mode: Oral 6-10 seconds

Axillary Mode 10-14 seconds

Rectal Mode 14-18 seconds

Direct Mode (All Sites): 60-120 seconds

Standard configura: tion

BLT digital SpO2, NIBP, Touch Screen, Rechargeable lithium ion battery.

Option: n

Masimo SpO2, Nellcor SpO2, Fast temperature, Microflow EtCO2, Thermal Printer, Rolling stand, Wall mount.



Biolight Meditech USA

Add: 535 Broadhollow Road Ste.B-24 Melville, New York 11747



V9

Advanced Vital Sign Monitor

PNE
PNE MEDICAL CARE CO., LTD.

Handwritten signature



V9

Advanced Vital Sign Monitor

Physiological alarm light

According to the different measurement results of the patient's vital signs, the physiological alarm was divided into 3 levels (High / Medium / Low), and the physiological condition of the patient was clearly indicated

Technical alarm light

thermal recorder

Monitor / Spot Check / Triage profile
Three profiles can switch easily, suitable for a variety of clinical needs, increase efficiency and staff satisfaction.

Masimo, Gold Standard SpO2 Solution
Masimo SET® SpO2 outperforms all other pulse oximetry technologies, providing clinicians with unmatched sensitivity and specificity.

Automatic oscillometry NIBP measurement.
The advanced algorithm can remove all kinds of human disturbances and make the measurement result more objective and repeatable.

Rechargeable Lithium battery can work more than 10 hours.

Covidien Filac 3000 Smart Electronic Thermometers
Provide the industry's most accurate and fastest readings in multiple easy-to-use formats

High-sensitivity 8" TFT color touch screen & Easy-to-use interface makes the operation more smoothly.




- Considerable ergonomic design of 12° screen angle gets you the best perspective.



- Philips LoFlo MicroFlow EtCO2 Sensor is ideal for use on adult, pediatric and infant patients with a sampling rate of 50 mL/min;

New card layout style software, easy to operate,

Different parameters with different color element, clear and easy to read.

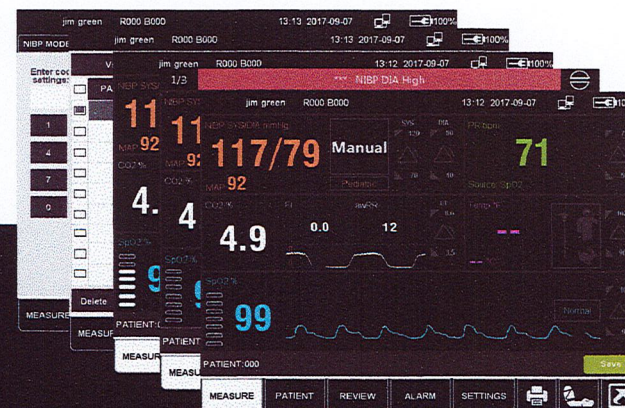

Other key features:



บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด

210 , 212 ถนนจ๊กกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270
Tel. 02-755-5759 , 02-175-6534 Fax. 02-1756534
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115553009803

ใบเสนอราคา

เลขที่	QT6608-0003
วันที่	07/08/2566

รหัสลูกค้า: C00043

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี
88/1 หมู่ที่ 8 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. โทรสาร

นำเสนอผ่าน
กำหนดส่งของ : 60 วัน ขึ้นราคาภายใน : 150 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน :

บริษัทฯ มีความยินดี ขอเรียนเสนอราคาสินค้าตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิมตัว ของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ BIOLIGHT รุ่น V9	4	เครื่อง	73,500.00	294,000.00
หมายเหตุ (Remark) รับประกัน 1 ปี				รวมเงิน	294,000.00
				ส่วนลดการค้า	
				เงินหลังหักส่วนลด	274,766.36
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	19,233.64
(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				จำนวนเงินทั้งสิ้น	294,000.00

ตกลงสั่งซื้อตามรายการข้างต้น

ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ

วันที่...../...../.....

PNC MEDICAL CARE CO., LTD

พนักงานขาย

วันที่...../...../.....

คุณภาณุภูมิ ชุ่มชูจันทร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย

วันที่...../...../.....

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อภายหลังจากวันที่กำหนดขึ้นราคา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น

เล่มที่ 190

ใบเสร็จรับเงิน

โรงพยาบาลบางพลี

ในราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่

เดือน

15 ក.ម. 2566

๒ ได้รับเงินจาก

ឧបត្ថម្ភ ដីចំណុះ ២០០០០ ៥៥៥ កំពុង

ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
1. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน: งบ วัสดุสำนักงาน 14,700	14,700
2. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน: งบ วัสดุสำนักงาน 14,700	14,700
3. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน: งบ วัสดุสำนักงาน 14,700	14,700
4. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน: งบ วัสดุสำนักงาน 14,700	14,700
รวม	14,700

จำนวนเงิน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ธ.ค. 64)

เล่มที่ สป. 001-500

(ตัวอักษร)

လၢၤစၢၤ

ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง (นางสาวจงกล สิ้นทรัพย์เกษตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



PNC MEDICAL CARE CO., LTD.